

# Q6 Edge<sup>®</sup> 2.0/2.0X/3/2.0HD/Q4<sub>2</sub>

MANUEL DE L'UTILISATEUR



*Contrôleur Q-Logic 3*



*Feux à del Montés  
Sur Les Ailes*



*Couleurs d'Accentuation  
des Roues*

## QUANTUM<sup>®</sup>

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

## CONSIGNES DE SECURITE

### MISE EN GARDE!

**Votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié doit faire le montage initial de ce fauteuil motorisé et suivre toutes les procédures énumérées dans ce manuel.**

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.

### MISE EN GARDE!

Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire sur un triangle jaune avec bordure noire.

### OBLIGATOIRE!

Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de vous blesser, et/ou d'endommager l'appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur blanche avec un point bleu et bordure blanche.

### INTERDIT!

Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire avec un rond rouge et barre rouge.

### Utilisation Prévue

L'usage prévu de ce dispositif médical Pride Mobility Products est de fournir une assistance de mobilité aux personnes à mobilité réduite qui ont la capacité de conduire un fauteuil roulant électrique.

### Concernant l'utilisation d'appareils fournis sur ordonnance

Nos produits de mobilité et leurs composants sont disponibles à la vente au détail (« en vente libre ») ou sur ordonnance. Lorsque prescrit, l'énoncé suivant s'applique.

### MISE EN GARDE!

**MISE EN GARDE!** La loi fédérale limite la vente de cet appareil par ou sur l'ordre d'un médecin ou d'un autre personnel certifié agréé par la loi de l'État (États-Unis uniquement) ou de la région dans laquelle ce personnel pratique pour utiliser ou ordonner l'utilisation de l'appareil.

*NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous réservons le droit d'apporter les changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site Internet.*

*NOTE: Ce produit répond aux exigences et respecte les directives des normes WEEE, RoHS et REACH.*

*NOTE: Ce produit conforme à la classification IPX4 (IEC 60529).*

*NOTE: Ce produit et ses composants ne sont pas faits avec du latex de caoutchouc naturel. Consultez le fabricant en ce qui concerne les accessoires d'après-vente.*

### Information utiles

Détaillant Quantum Rehab: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Date d'achat: \_\_\_\_\_




## Table des matières

Introduction.....	5
Sécurité .....	6
Votre fauteuil motorisé.....	7
Assemblage .....	11
Réglages confort .....	15
Batteries et recharge.....	19
Soins et entretien .....	23

**ENONCE CONSULTATIF CONCERNANT CERTAINS COMPOSANTS INTEGRES PAR DES FABRICANTS TIERS DANS DES FAUTEUILS MOTORISES FINIS:** Lorsque des bases électriques, des systèmes de sièges ou d'autres composants sont incorporés dans un fauteuil motorisé fini fabriqué ou assemblé par un tiers, ce tiers est responsable d'en assurer la sécurité, la fonctionnalité et conformité légale du fauteuil motorisé fini. Nous ne faisons aucune déclaration concernant la sécurité, la fonctionnalité ou la conformité légale du fauteuil motorisé fini ou de ses composants fabriqués par un tiers. Bien que nous fassions tout notre possible pour nous assurer que nos composants sont distribués de manière responsable, nous rappelons aux fabricants, distributeurs et consommateurs que les fauteuils motorisés finis doivent être conformes à diverses normes et exigences gouvernementales en matière de sécurité et de fonctionnalité.

S'il est nécessaire de modifier physiquement un fauteuil motorisé, y compris l'ajout de composants tiers, pour répondre aux besoins médicaux de l'occupant du fauteuil motorisé, une évaluation des risques conforme à la norme ISO 14971, comme indiqué dans ISO\_7176, doit être effectuée.

Les changements aux fauteuils motorisés susceptibles d'affecter la conformité et l'évaluation des risques comprennent, mais sans s'y limiter: le déplacement des supports des points de fixation; abaisser la hauteur du dossier; raccourcir la longueur du siège; l'ajout de supports posturaux secondaires qui ne sont pas fermement attachés au fauteuil motorisé; ajouter des composants qui ont des arêtes vives (c'est-à-dire des arêtes avec un rayon inférieur à 0,08 po [2 mm]); ou tout changement qui compromet l'intégrité structurelle du cadre du fauteuil motorisé.

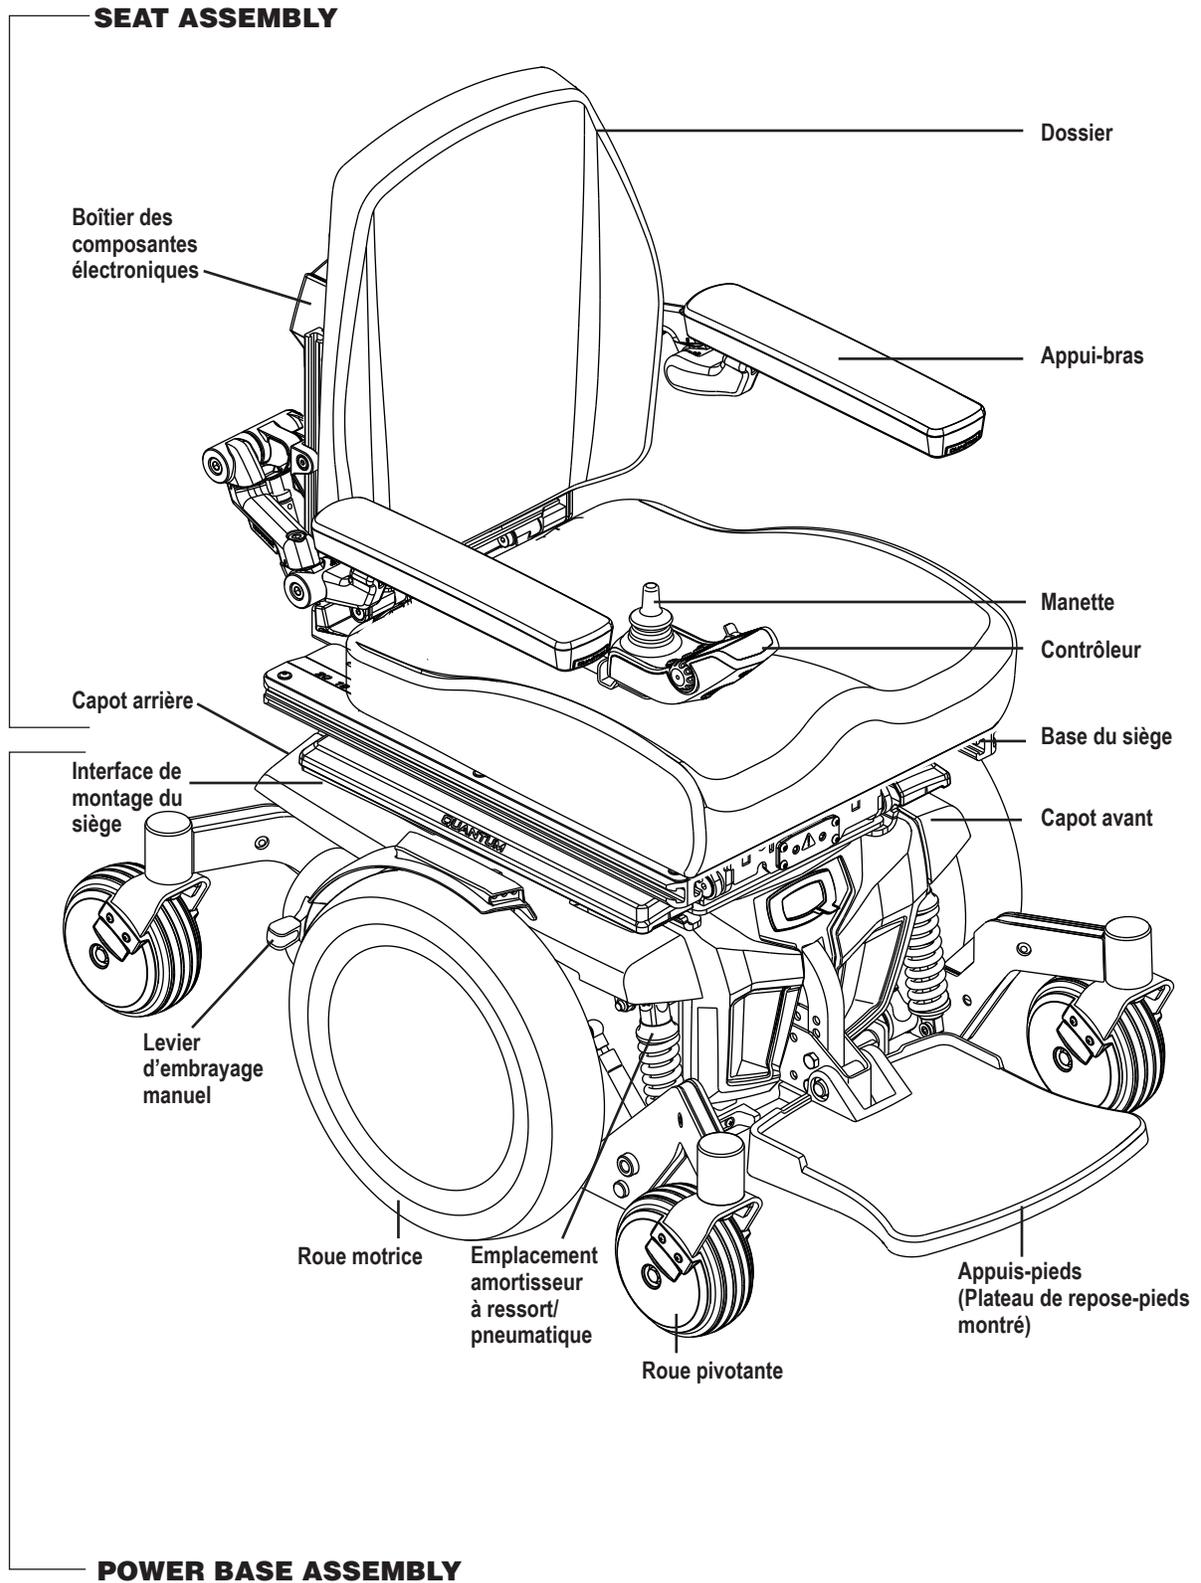

## Sécurité

BIENVENUE chez Quantum Rehab. Votre fauteuil motorisé est un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une technologie d'avant-garde mais surtout sécuritaire et confortable. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités et les services qu'il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait. Lorsque vous serez accoutumé avec le fonctionnement sécuritaire et l'entretien de votre fauteuil motorisé, celui-ci vous fournira plusieurs années de service sans problèmes.

Lisez et suivez toutes les instructions, mises en garde et notes contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser votre fauteuil motorisé pour la première fois. Vous devez de plus, lire toutes les instructions, mises en garde et notes contenues dans le manuels d'instructions supplémentaires du contrôleur, des repose-pieds, et/ou systèmes qui accompagnent votre fauteuil motorisé avant de l'utiliser pour la première fois. Votre sécurité dépend de l'attention et du bon jugement que vos proches et vos professionnels y porteront.

Si vous ne comprenez pas quelque information contenue dans ce manuel ou si vous avez besoin d'aide pour préparer ou faire fonctionner votre appareil, S.V.P. contactez votre détaillant Quantum Rehab. **Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil peut provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l'annulation de la garantie.**

## Convention à l'achat

En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protecteurs, gardes de sécurité et/ou dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer les trousse de mise à jour au besoin, fournies par Quantum Rehab afin de maintenir ou améliorer l'aspect sécuritaire de votre fauteuil motorisé.

## Transport et réception du fauteuil motorisé

Vérifiez que vous avez bien reçu l'ensemble des composantes avant d'utiliser votre fauteuil motorisé car certaines composantes peuvent avoir été emballées séparément. Si des pièces sont manquantes, S.V.P. contactez votre détaillant Quantum Rehab immédiatement. Si vous constatez des dommages au contenant ou au contenu subis lors du transport, contactez le transporteur responsable.

**NOTE: Si vous perdez ou égarez votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, ce sera avec plaisir que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.**



## Pictogrammes de sécurité

Les pictogrammes ci-dessous sont apposés sur le fauteuil pour indiquer les actions obligatoires, mises en garde et actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les comprendre.

**NOTE: Vous trouverez davantage d'avertissements identifiés et expliqués dans le guide de la sécurité du consommateur inclus avec votre fauteuil motorisé. Veuillez-vous familiariser avec tous les avertissements et les consignes de sécurité contenus dans le guide de la sécurité du consommateur et référez-vous souvent à cette ressource.**



Lisez et suivez les consignes et informations contenues dans ce manuel.

Verrouillé et embrayé



Placez la fauteuil sur une surface à niveau et tenez vous debout sur le côté le fauteuil lorsque vous le désengagez ou lorsque vous l'engagez.

Déverrouillé et débrayé



ou



Indique les points de fixation du fauteuil motorisé OCCUPES



ou



Indique les points de fixation du fauteuil motorisé INOCCUPE



Indique que le fauteuil motorisé, équipé d'un système de siège possédant des vignettes similaires, est conforme aux normes ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Section 19 pour le transport de ce fauteuil occupé dans un véhicule moteur.



Indique que le fauteuil motorisé avec une étiquette similaire n'est pas conçu pour le transit occupé.



Équipement de classe II



ou



Fabriqué en



Étiquette d'informations fauteuil motorisé



Point d'accès au filage. Pour utilisation lors de l'entretien seulement.

## Consignes de générales



### OBLIGATOIRE!

**Ne prenez pas votre fauteuil pour la première fois sans avoir lu et compris les instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.**

Votre fauteuil motorisé est un appareil dernier cri, à la fine pointe de la technologie, conçu pour améliorer la mobilité des personnes. Votre détaillant Quantum Rehab propose une grande variété des meilleurs fauteuils capables de satisfaire les besoins de chacun. C'est à l'utilisateur et/ou son conseiller médical (médecin, ergothérapeute, etc.) qu'appartient la décision finale lors du choix du modèle à acheter.

Il est convenu que le contenu de ce manuel est basé sur la certitude que le fauteuil a été configuré pour l'utilisateur par un expert et que celui-ci a conseillé les professionnels de la santé impliqués au sujet des consignes d'utilisation de ce produit.

Dans certaines situations, incluant des conditions médicales, la présence d'une personne aidante sera nécessaire afin d'aider l'utilisateur à se familiariser et se pratiquer avec son nouveau fauteuil. La personne aidante peut être un membre de la famille ou un professionnel de la santé formé pour ce type de situation.

Lorsque vous commencerez à utiliser votre fauteuil pour vos activités quotidiennes, vous ferez probablement face à des situations qui demanderont une certaine habileté. Prenez votre temps et bientôt vous développerez l'habileté et l'assurance pour manoeuvrer dans les portes, prendre l'ascenseur, monter et descendre des rampes et rouler sur des terrains légèrement accidentés.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous aideront à vous familiariser avec le fonctionnement de votre fauteuil motorisé.

### Vérification avant départ

Apprenez à connaître les capacités et les limites de votre fauteuil. Quantum Rehab recommande de faire les vérifications suivantes avant chaque utilisation pour assurer un fonctionnement sécuritaire et en douceur.

### Avant d'utiliser votre fauteuil, vérifiez les points suivants:

- Vérifiez la pression dans les pneus. Maintenir, sans toute fois excéder, la pression en psi/bar/kPa indiquée pour chaque pneu si votre fauteuil motorisé en est équipé.
- Inspectez les raccords électriques. Assurez-vous qu'ils soient bien serrés et libres de corrosion.
- Vérifiez toutes les connexions du module de contrôle à la base motrice. Assurez-vous qu'elles soient branchées de façon sécuritaire.
- Vérifiez les freins. Voyez "Soins et entretien".
- Vérifiez le niveau de charge des batteries. Voyez "Batteries et recharge".
- S'assurer que les leviers manuels de roue libre sont en mode entraînement avant de s'asseoir sur le fauteuil motorisé.

**NOTE:** Si vous décelez un problème, contactez votre détaillant Quantum Rehab pour obtenir de l'aide.

### Le Q6 Edge 2.0/3/2.0HD/Q4 2

Votre fauteuil motorisé possède deux composantes principales: le module de siège et la base motorisée. Typiquement, le module de siège est composé des appuis-bras, du dossier et de la base du siège. La base motorisée comprend un ensemble moteur/freins double, deux roues centrales, quatre roues pivotantes, deux batteries et les composantes électroniques. Voir Q6 Edge 2.0/3/2.0HD/Q4 2 (page 4) et la figure 1.

### Composantes électriques

Les composantes électriques sont le contrôleur, les batteries et les moteurs. Les batteries, les moteurs et le module d'alimentation du contrôleur (si équipé) sont situés sur la base motorisée. Le contrôleur est situé sur le module de siège. Les composantes sont reliées entre elles à l'aide de un ou plusieurs câbles. Voir la figure 1.

**Connecteur du contrôleur:** Endroit où le contrôleur se branche à la base motorisée. Chaque contrôleur utilise un type différent de câble. Sans égard au type de contrôleur utilisé, le câble doit toujours être fixé de façon à ce que celui-ci ne traîne pas sur le plancher.

**Connecteurs des moteurs:** Réceptacles pour le branchement des moteurs à la base motorisée.

**Connecteurs des batteries:** Réceptacles pour le branchement des batteries à la base motorisée.

**Module d'alimentation du contrôleur:** Celui-ci établit le contact entre les batteries et les moteurs.

**Disjoncteur circuit principal (situé sur l'arrière de la châssis):** Composantes de sécurité qui protègent votre fauteuil. Lorsque les batteries sont trop faibles ou que la demande est trop importante (exemple: surcharge de poids), le disjoncteur principal coupera l'alimentation aux moteurs et aux circuits électroniques afin de les protéger. Si le disjoncteur saute, laissez reposer votre fauteuil quelques minutes, enfoncez le disjoncteur à nouveau, remettez le contact et continuez votre route. Si le disjoncteur saute à nouveau, faites vérifier votre appareil chez votre détaillant Quantum Rehab.

### Leviers d'embrayage manuel

Votre fauteuil motorisé est équipé de deux leviers d'embrayage manuel « pour passer au neutre » un sur chaque moteur. Ces leviers vous permettent de débrayer les moteurs de la boîte de vitesse, afin de pouvoir manoeuvrer


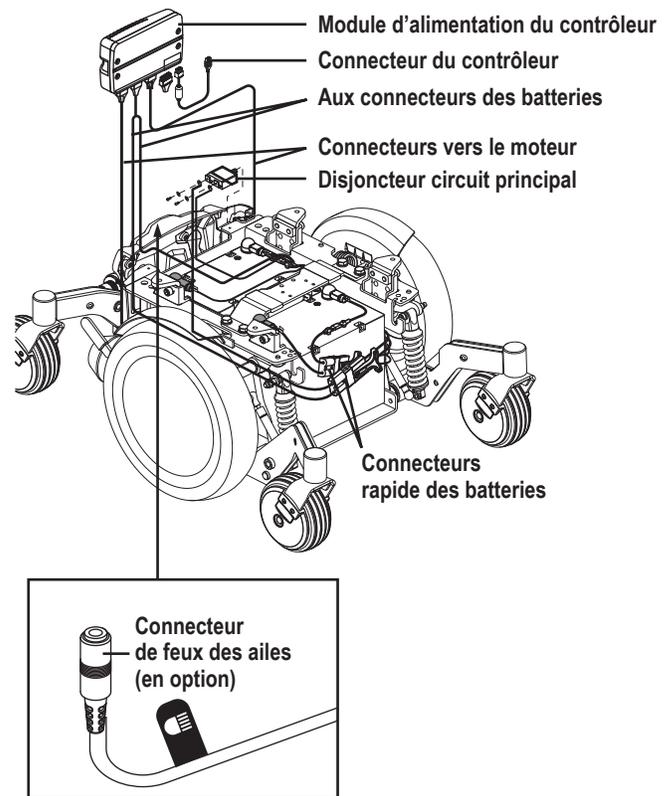


Figure 1. Composantes électroniques

### Mode « roues libres »

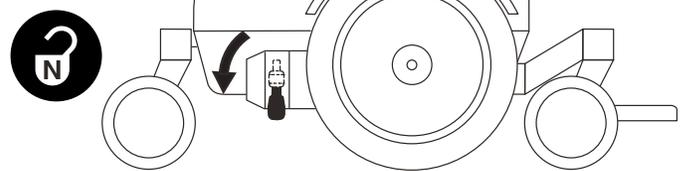

### Mode de traction

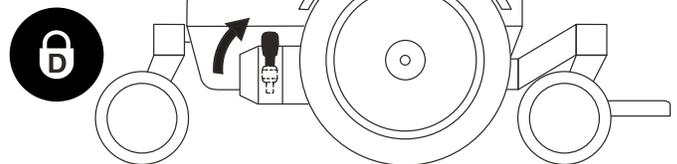


Figure 2. Fonctionnement du levier d'embrayage manuel

### MISE EN GARDE!

N'utilisez jamais votre fauteuil motorisé lorsque les moteurs sont débrayés. Ne laissez jamais votre fauteuil débrayé (neutre) lorsqu'il est sur une surface inclinée car il risque de rouler de lui-même. Débrayez le fauteuil seulement lorsque celui-ci est sur une surface horizontale.

### MISE EN GARDE!

Rappelez-vous que lorsque le fauteuil motorisé est débrayé, les freins électriques sont relâchés.

Pour le fonctionnement des leviers:

1. Poussez les deux leviers vers le bas pour débrayer le fauteuil et passer au neutre (moteurs désengagés). **Voir la figure 2.**
2. Tirez sur les deux leviers pour embrayer les moteurs et passer en mode de fonctionnement. **Voir la figure 2.**

### OBLIGATOIRE!

Vous devez couper le contact avant de débrayer les moteurs sous peine de provoquer un message d'erreur sur le contrôleur. Pour éliminer un message d'erreur, coupez le contact, et embrayez le fauteuil. Mettez le contact à nouveau, le message devrait être éliminé. Si le message persiste, contactez votre détaillant Quantum Rehab.

**REMARQUE:** Le fauteuil est beaucoup plus facile à déplacer lorsque le contact est coupé.

### MISE EN GARDE!

N'utilisez pas une force excessive sur les leviers d'embrayage.

Ne placez pas vos pieds sur les leviers d'embrayage. Ne vous tenez pas debout sur les leviers. Une trop grande force appliquée sur les leviers peut endommager les moteurs, les freins et les leviers.

N'utilisez pas les leviers d'embrayage comme point d'ancrage du fauteuil.

#### Fonction iLevel® (en option)

Votre fauteuil motorisé peut être équipé de la fonction iLevel qui sera utilisée en conjonction avec un système de siège. La fonction iLevel est installée sur une base motorisée Quantum pour une stabilité maximale lorsque le système de siège est élevé. **Voir la figure 3.**

**REMARQUE:** Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un système de positionnement motorisé TRU-Balance® 3, reportez-vous aux informations fournies dans le manuel d'utilisation inclus dans la trousse du propriétaire.

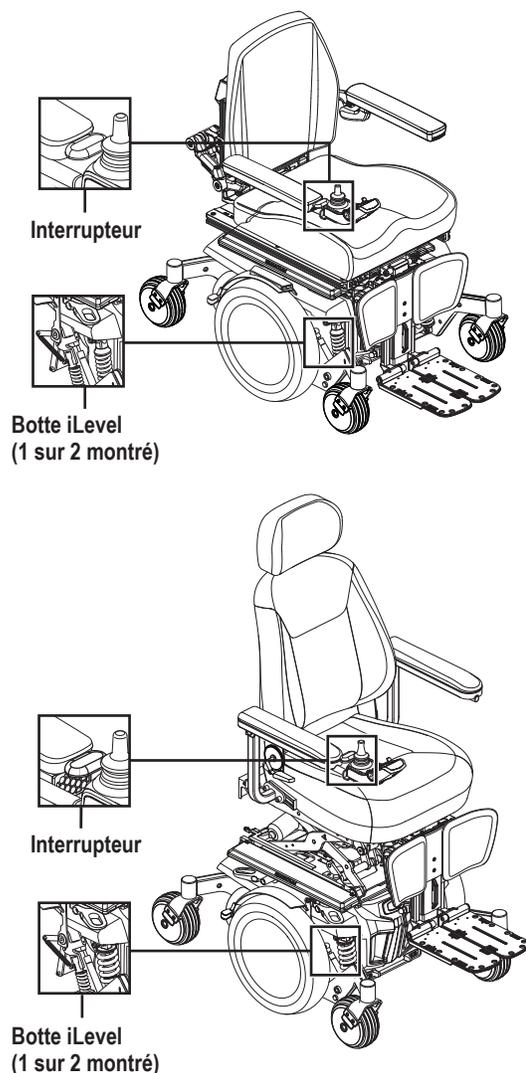


Figure 3. La fonction iLevel®

## OBLIGATOIRE!

Avant d'utiliser la fonction iLevel, veuillez lire attentivement ce qui suit. Ces lignes directrices sont fournies pour vous aider à exploiter la fonction iLevel en toute sécurité.

- Coupez l'alimentation avant de vous asseoir dans votre fauteuil motorisé.
- Toujours avoir une assistance quand vous allez vous asseoir dans ou lors du transfert dans votre fauteuil motorisé.
- Suivez toutes les procédures et respectez tous les avertissements comme expliqué dans le manuel du propriétaire, manuels supplémentaires, et le guide de la sécurité des consommateurs.

## MISE EN GARDE!

Le centre de gravité de votre fauteuil a été réglé en usine à une position qui répond aux besoins de la majorité des utilisateurs. Votre détaillant Quantum Rehab a évalué votre système de siège et a effectué les réglages nécessaires afin de répondre à vos besoins spécifiques. Ne jamais modifier votre configuration de siège sans avoir préalablement contacté Quantum Rehab ou votre détaillant Quantum Rehab.

Certaines composantes de votre fauteuil sont lourdes. Demandez de l'aide pour les soulever ou les déplacer. Veuillez vous référer au tableau des spécifications pour connaître le poids de chacun des éléments avant de démonter votre fauteuil motorisé.

Le fauteuil ne doit pas être occupé lors des changements des réglages.

**REMARQUE:** La fonction iLevel est automatiquement activée lorsque le siège élévateur motorisé est activé et l'indicateur iLevel s'affiche sur votre contrôleur.

La fonction iLevel est accessible à partir du contrôleur ou interrupteur, et le fauteuil motorisé doit être sur une surface de niveau à l'intérieur pour activer iLevel. Une fois que l'actionneur du système de sièges est démarré, les botes iLevel (voir la figure 3) inhibent le mouvement des bras de roulettes avant. Le système de siège peut être incliné ou basculé jusqu'à 20° tandis que la fonction iLevel est activée.

**REMARQUE:** Pour plus d'informations sur les avertissements iLevel affichés, reportez-vous aux instructions d'exploitation de base de votre contrôleur.

La fonction iLevel ne peut être utilisée que sur des surfaces intérieures planes, de niveau, comme dans les centres commerciaux, les bureaux et/ou les installations médicales, et seulement sur des surfaces extérieures limitées, planes et de niveau.

Pendant que la fonction iLevel est en cours d'utilisation, le fauteuil motorisé peut se déplacer à une vitesse de sécurité prédéterminée. Reportez-vous au tableau des spécifications pour de plus amples informations sur la réduction de la vitesse maximale.

## MISE EN GARDE!

La fonction iLevel doit être utilisée uniquement sur une surface intérieure plane et nivelée, comme dans les centres commerciaux, les bureaux et/ou les établissements médicaux. Ne soulevez jamais le siège depuis sa position la plus basse sur une surface inclinée ou inégale ou lorsque vous tentez de négocier ou de monter/descendre une surface surélevée ou abaissée. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner le basculement du fauteuil motorisé.

La fonction iLevel est conçue pour une utilisation extérieure limitée uniquement sur surfaces planes et de niveau. Si vous n'êtes pas sûr de votre environnement, n'utilisez pas iLevel à l'extérieur.

Ne jamais élever le siège de sa position la plus basse lorsque vous utilisez votre fauteuil motorisé sur des surfaces accidentées ou inégales. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner le renversement du fauteuil.

Toujours attacher la ceinture de positionnement lors de l'utilisation du le fauteuil motorisé.

Ne pas utiliser le iLevel ou changer la hauteur du siège d'aucune façon alors que votre télésiège est placé sous un objet fixe tel qu'une table ou un bureau. Garder l'endroit dégagé avant et pendant le mouvement.

## INTERDIT!

N'utilisez jamais la fonction iLevel à l'extérieur sur un terrain accidenté (gravier, collines ou autre terrain accidenté, non compact) ou dans des champs.

**REMARQUE:** La fonction iLevel est équipée d'un système qui permet au fauteuil motorisé de se déplacer à une vitesse de sécurité prédéterminée lorsque le siège est élevé. Toujours vérifier pour être sûr que ce système fonctionne correctement avant d'utiliser votre fauteuil motorisé.

**REMARQUE:** Si un avertissement ou indicateur visuel apparaît sur votre contrôleur indiquant que iLevel n'est pas engagé, la vitesse du fauteuil motorisé sera réduite à 25% lorsqu'il est élevé. Si cet avertissement apparaît au niveau du sol, veuillez cesser d'utiliser la fonction iLevel et consulter votre détaillant Quantum Rehab pour de l'aide.

**Feux montés sur les ailes (en option)**

Votre fauteuil motorisé peut être équipé de feux montés sur les ailes. Les feux sont composés de trois lumières DEL blanches à l'avant et trois lumières DEL rouges à l'arrière et sont montés sur les ailes de votre base motorisée. **Voir la figure 4.**

**REMARQUE:** Avant la première utilisation, veiller à ce que l'interrupteur de le feux des ailes est connecté.

**REMARQUE:** Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un contrôleur préposé, les feux des ailes vont activer l'aide d'une combinaison contrôleur/interrupteur simple lorsque le contrôleur est allumé.

Les feux des ailes fonctionnent via interrupteur simple.

**Pour allumer les feux des ailes via un interrupteur simple:**

1. Appuyez sur l'interrupteur une seule fois pour allumer les feux des ailes.
2. Appuyez sur l'interrupteur encore une fois pour éteindre les feux des ailes.

**REMARQUE:** Installer le commutateur simple à l'extérieur du fauteuil motorisé, par exemple, sur le rail latéral, peut augmenter la largeur totale du fauteuil motorisé.

 **MISE EN GARDE!**

L'interrupteur unique doit être monté à un endroit pratique pour l'utilisateur du fauteuil motorisé et où le faisceau de l'interrupteur ne sera pas pris dans les roues motrices ou le train roulant, pincé dans le cadre du siège ou endommagé lors du passage des portes.

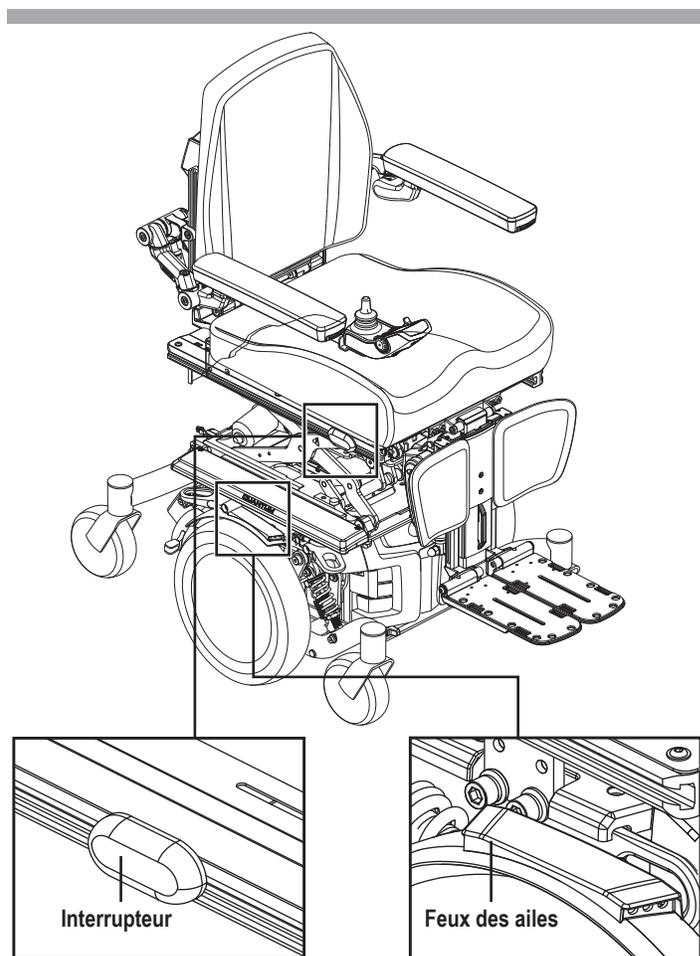


Figure 4. Interrupteur simple pour allumer les feux des ailes

## Assemblage initial

Il se peut que vous ayez à faire un assemblage partiel de votre fauteuil avant la première utilisation ou après l'avoir transporté. Il se peut que vous ayez à le démonter partiellement pour faire des réglages confort. La figure 5 montre les composantes du fauteuil motorisé qui sont conçues pour être soit assemblées ou démontées par son utilisateur ou une personne qualifiée.

**REMARQUE:** Tout écrou autobloquant à insertion de nylon retiré pendant le démontage ou lors de réglage du fauteuil motorisé doit être remplacé par un écrou neuf. Les écrous à insertion de nylon ne doivent pas être réutilisés car ils s'endommagent et n'offrent plus un serrage sécuritaire. Des écrous de remplacement à insertion de nylon sont disponibles dans toutes les quincailleries ou chez votre détaillant Quantum Rehab.

## Installation du siège

Il se peut que vous ayez à installer le siège avant la première utilisation ou après avoir transporté votre fauteuil motorisé. La plupart des sièges sont fixés à la base à l'aide du « Système de Montage Universel » (SMU). Le système de montage universel (SMU) est composé de pièces compatibles au siège sans égard à la largeur ou à la profondeur du siège. Les deux pièces principales sont des cornières d'aluminium montées sur la base du siège. Celles-ci se fixent sur la paire de barres trapèze fixées sur la base motorisée. Voir la figure 6.

**REMARQUE:** Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un Siège Synergy ou d'un système TRU-Balance® 3 Power Positioning, référez-vous au manuel d'information fourni avec le système.

### ⚠ MISE EN GARDE!

Ne soulevez pas la siège par les appuis-bras. Ils peuvent pivoter et vous faire perdre le contrôle.

### Pour installer le siège:

1. Inclinez le siège vers l'arrière et glissez la cornière arrière sur la barre trapèze arrière. Voir la figure 6.
2. Abaissez la cornière avant sur la barre avant jusqu'à ce que le siège se bloque en place.
3. Basculez le loquet vers la bas.

### ⚠ MISE EN GARDE!

Assurez-vous de bien engager le loquet de sécurité avant d'utiliser votre fauteuil motorisé.

4. Installez le contrôleur et passez le câble vers l'arrière de la base motorisée. Voir la figure 7, 8, 9 or 10.

### Ⓚ OBLIGATOIRE!

Prévenez les dommages au harnais du contrôleur ! Évitez d'acheminer le faisceau du contrôleur à l'extérieur du coussin de l'accoudoir. Faites passer le harnais sous l'accoudoir ou vers l'intérieur du rembourrage de l'accoudoir. Utilisez des points d'arrimage corrects pour le faisceau du contrôleur afin d'éviter que le faisceau ne se coince dans les roues, soit pincé dans le cadre du siège ou endommagé lors du passage des portes.

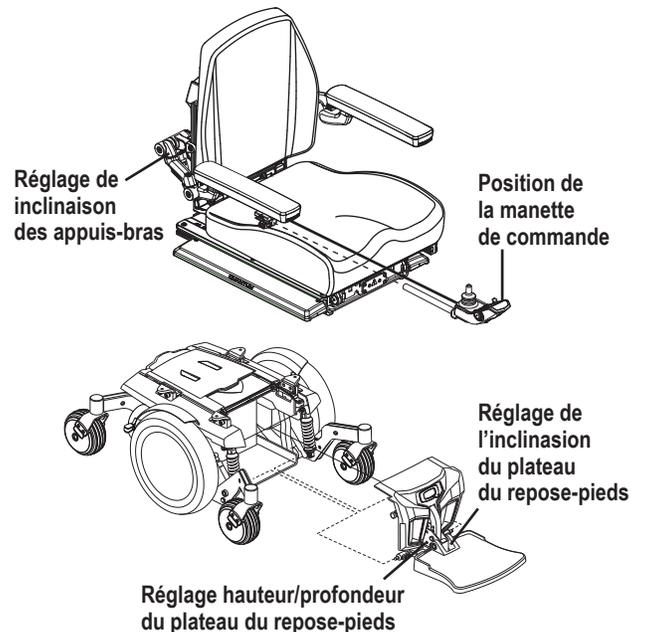


Figure 5. Vue de l'assemblage du fauteuil

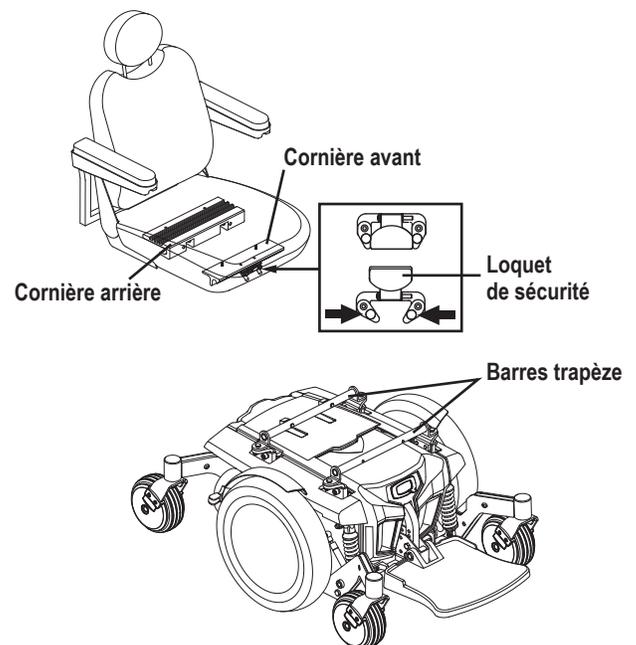


Figure 6. Système de montage universel et siège Contour

5. Branchez le connecteur du contrôleur dans la base motorisée. **Voir la figure 1.**
6. Fixez le câble du contrôleur sous l'accoudoir avec des attaches pour fil. **Voir la figure 7, 8, 9 ou 10.**

### Installation du siège élévateur

Votre fauteuil motorisé peut être équipé d'un siège électrique élévateur optionnel. Même si le siège lui-même peut être l'un de plusieurs styles pour ce modèle de fauteuil motorisé, il sera fixé à la base motorisée de manière différente.

#### Pour installer le siège électrique élévateur:

1. Alignez le siège avec le réceptacle de l'actionneur. **Voir la figure 11.**
2. Insérez les vis de blocage dans l'actionneur et serrez bien.
3. Placez le système de siège sur le support d'interface et fixez le en place.
4. Brancher le câble du commutateur à bascule du siège électrique.

### Système d'ancrage pour le transport

Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un système d'ancrage pour le transport, celui-ci possède des supports avant et arrière pour l'ancrage et peut être équipé des supports pour la fixation de la ceinture de positionnement. **Voir la figure 12.** Référez-vous aux informations supplémentaires contenues dans le manuel du fauteuil motorisé pour les instructions sur l'utilisation du système d'ancrage.

### Transport de votre fauteuil motorisé

Vous pouvez sécuriser le fauteuil motorisé par l'une des deux méthodes suivantes:

1. À ses points d'arrimage avec un système d'arrimage de type sangle qui s'adapte correctement à la masse totale du fauteuil motorisé et est conforme à la norme ISO 10542-1, une norme internationale régissant les systèmes d'arrimage et de retenue des occupants des fauteuils roulants (WTORS).

**REMARQUE:** Si vous utilisez la méthode d'arrimage, veuillez vous reporter au « Guide des systèmes de sécurisation des transports en commun » séparé de Quantum Rehab.

2. Avec un fauteuil motorisé de type station d'accueil et un système de retenue des occupants qui a été testé et est conforme à la norme ISO7176-19, une norme internationale régissant les tests des fauteuils motorisés utilisés comme sièges dans les véhicules à moteur.

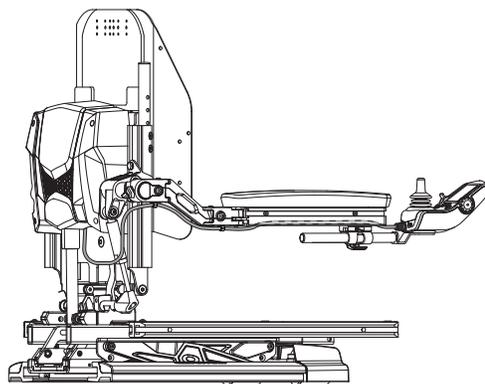


Figure 7. Câble sécurisé sur un TRU-Balance® 3

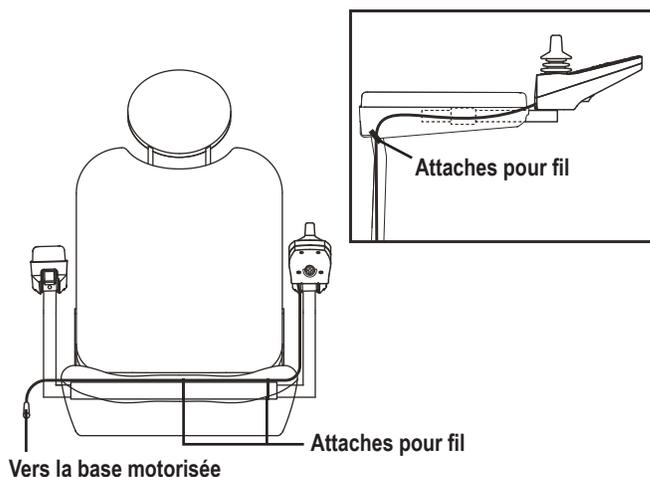


Figure 8. Câble sécurisé sur un siège Contour

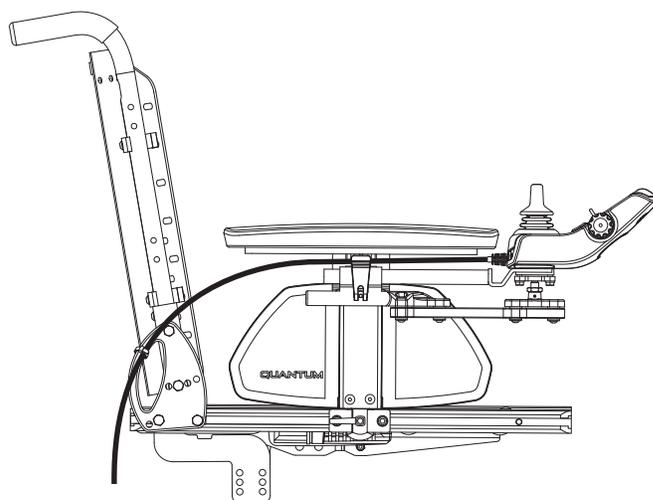


Figure 9. Câble sécurisé sur un siège TB-Flex

**REMARQUE:** Le DAHL Docking mk. II et le DAHL VarioDock Les systèmes ont été testés avec le Q6 Edge 2.0/3 et être conforme à la norme ISO 7176-19. Pour une installation et une utilisation en toute sécurité, veuillez vous référer au « Q6 Edge » distinct de Quantum Rehab. Instructions d'installation de la base d'alimentation 2.0/3 pour le DAHL Plaque de verrouillage des systèmes d'accueil d'ingénierie » et DAHL instructions d'utilisation sur la façon d'utiliser les systèmes d'accueil et installez-les dans un véhicule.

**REMARQUE :** DAHL ne s'applique pas aux lecteurs 2.0HD.

Le fauteuil motorisé doit être transporté uniquement dans des véhicules approuvés pour cet achat.

### MISE EN GARDE!

Certains symboles situés sur la base de votre fauteuil motorisé indiquent si votre fauteuil motorisé est homologué pour le transport OCCUPÉ ou NON OCCUPÉ dans un véhicule à moteur. Veuillez vous reporter aux symboles de sécurité du produit représentés et expliqués à la page 6 de ce manuel pour confirmer si le symbole sur votre fauteuil motorisé indique qu'il est conçu pour le transport OCCUPÉ ou NON OCCUPÉ dans un véhicule à moteur. Si vous ne parvenez pas à identifier ou à localiser un symbole indiquant OCCUPÉ ou NON OCCUPÉ, veuillez contacter votre fournisseur Quantum Rehab pour obtenir de l'aide. De plus, avant de fixer votre fauteuil motorisé dans un véhicule à moteur, vous devez lire et suivre toutes les instructions, avertissements et notes contenus dans le Guide des systèmes de fixation Transit, qui est fourni avec votre fauteuil motorisé.

### Points d'ancrage du fauteuil motorisé

Votre fauteuil peut être équipé de quatre (4) points d'ancrage servant à l'attacher lorsque celui-ci est inoccupé dans un véhicule de transport. Chaque point est clairement identifié à cet effet.

### Pour ancrer un fauteuil motorisé équipé de points d'attache:

- Le fauteuil motorisé doit toujours être ancrés face à l'avant du véhicule.
- Fixez les quatre (4) courroies aux points d'ancrage désignés et identifiés par le symbole d'ancrage sur le fauteuil motorisé. **Voir les figures 12 et 13.** Serrez-bien les courroies pour retirer le jeu excessif.
- N'attachez jamais le fauteuil par ses composantes réglables ou mobiles tels que les accoudoirs, roues ou les repose-pieds.
- Positionnez les points d'ancrage arrière des courroies directement derrière le fauteuil motorisé. Les points d'ancrage avant sont disposés plus loin de chaque côté du fauteuil motorisé afin d'augmenter la stabilité latérale. **Voir la figure 13.**

### OBLIGATOIRE!

Le fauteuil motorisé doit être utilisé en accord avec les instructions du fabricant. Si vous avez des questions concernant l'usage adéquat de votre fauteuil motorisé, contactez votre détaillant Quantum Rehab.

### MISE EN GARDE!

Le siège du fauteuil motorisé ne doit jamais être relevé ou surélevé lorsque le fauteuil motorisé est fixé dans un véhicule ou dans un passage occupé ou inoccupé. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

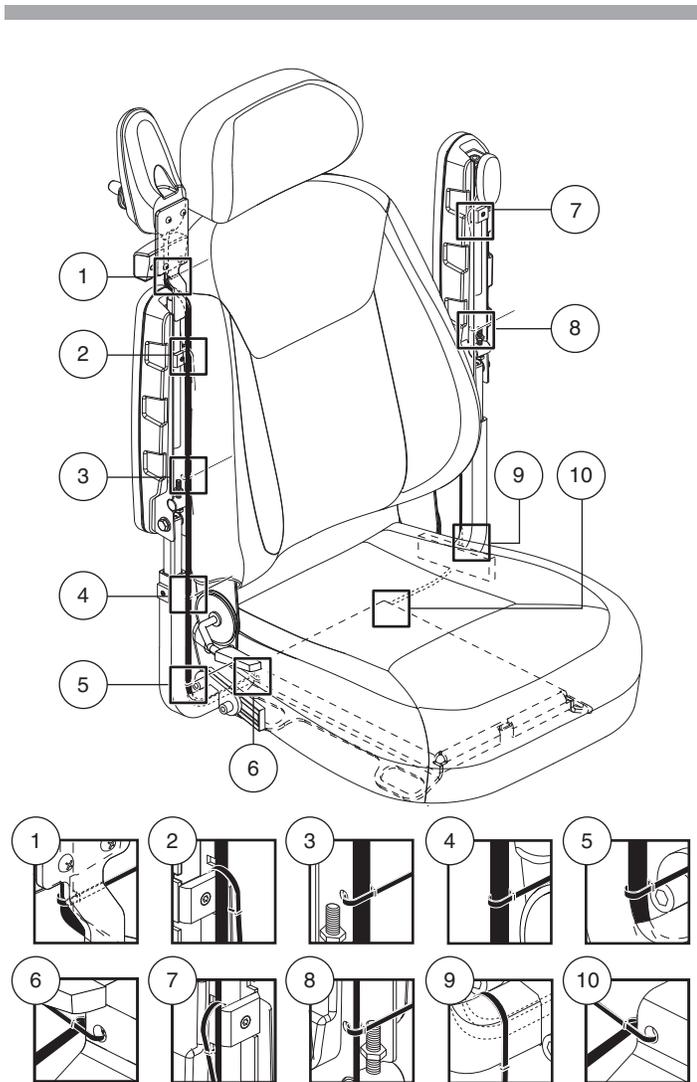


Figure 10. Câble sécurisé sur un siège avec iLevel

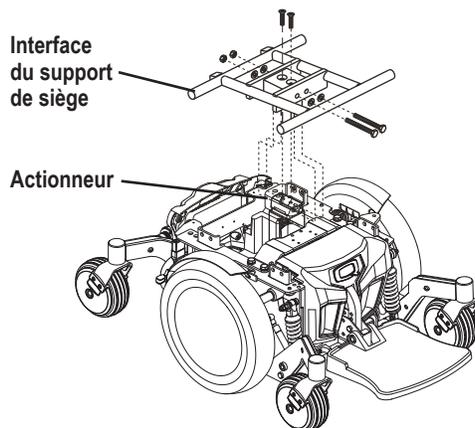


Figure 11. Actionneur du siège électrique éleveur

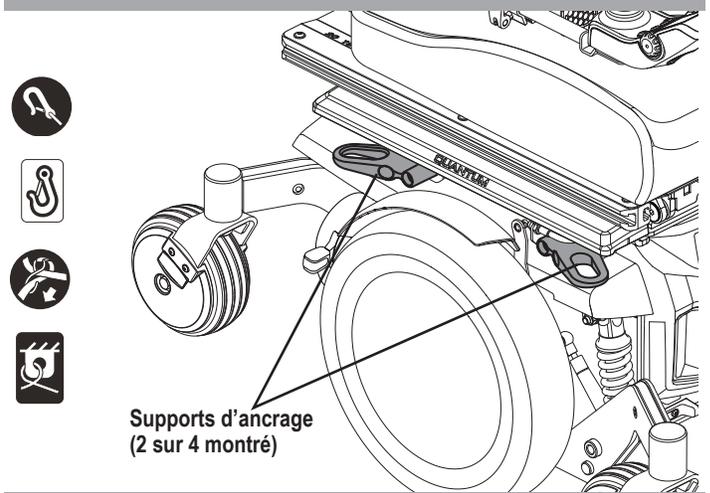


Figure 12. Support d'ancrage système transport

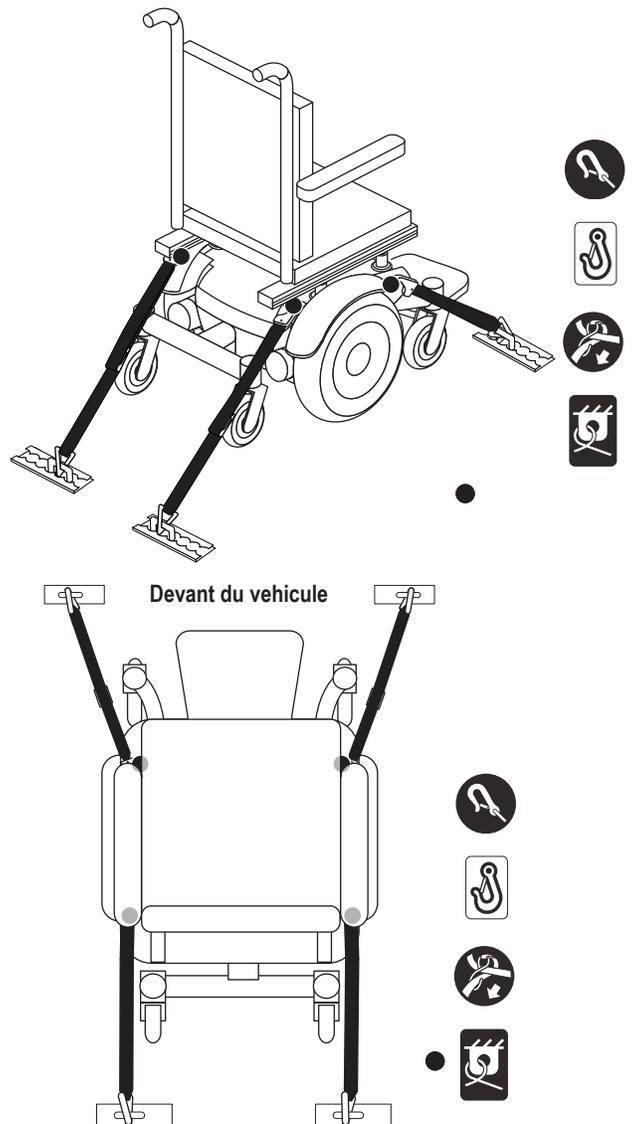


Figure 13. Points d'ancrage pour fauteuil motorisé non occupé

## Réglages confort

Dès que vous vous serez habitué aux fonctions de votre fauteuil motorisé, vous aurez probablement envie d'effectuer des réglages confort, tels que la hauteur et l'angle du siège, le réglage de la hauteur, de la profondeur, et de l'angle des appuis-bras, le réglage de la hauteur, le profondeur, et de l'angle du repose-pieds ainsi que la position de la manette de commande.

**REMARQUE:** Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un Siège Synergy ou d'un système TRU-Balance 3 Power Positioning, référez-vous au manuel d'information fourni avec le système. Si votre fauteuil est équipé d'un siège de type contour, référez-vous aux informations ci-dessous.

### ⚠ MISE EN GARDE!

La position du centre de gravité de votre fauteuil motorisé a été réglé à l'usine en tenant compte des besoins de la majorité des utilisateurs. Votre détaillant Quantum Rehab a analysé votre fauteuil motorisé et a apporté les ajustements requis afin de satisfaire vos besoins spécifiques. N'apportez aucune modification à la configuration de votre fauteuil sans avoir au préalable contacté Quantum Rehab ou votre détaillant Quantum Rehab.

Certaines composantes de votre fauteuil sont lourdes. Demandez de l'aide pour les soulever ou les déplacer. Veuillez vous référer au tableau des spécifications pour connaître le poids de chacun des éléments avant de démonter votre fauteuil motorisé.

Le fauteuil ne doit pas être occupé lors des changements des réglages.

Vous aurez besoin des outils suivants pour faire les réglages:

- ensemble de clés à rochet métriques/standards
- clé ajustable
- ensemble de clés hexagonales métriques/standards
- liquide frein-filet

### Réglage de la hauteur et de l'angle du siège

Si votre fauteuil motorisé n'est pas équipé d'un système d'arrimage de transit, vous pouvez changer la hauteur du siège sur trois niveaux en haussant les barres trapèze. Si vous haussez ou abaissez seulement une barre trapèze (avant ou arrière), vous pouvez changer l'inclinaison du siège (bascule).

### ■ OBLIGATOIRE!

Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un système d'arrimage de transit et n'importe quel ajustement de la hauteur ou de l'angle du siège est nécessaire, contactez votre détaillant Quantum Rehab. Ces réglages de confort ne peuvent être faits que par un détaillant Quantum Rehab.

Pour changer la hauteur du siège:

1. Coupez le contact (off).
2. Assurez-vous que le fauteuil motorisé est embrayé.
3. Débranchez le/les connecteur(s) du contrôleur de la base motorisée. Voir la figure 1.

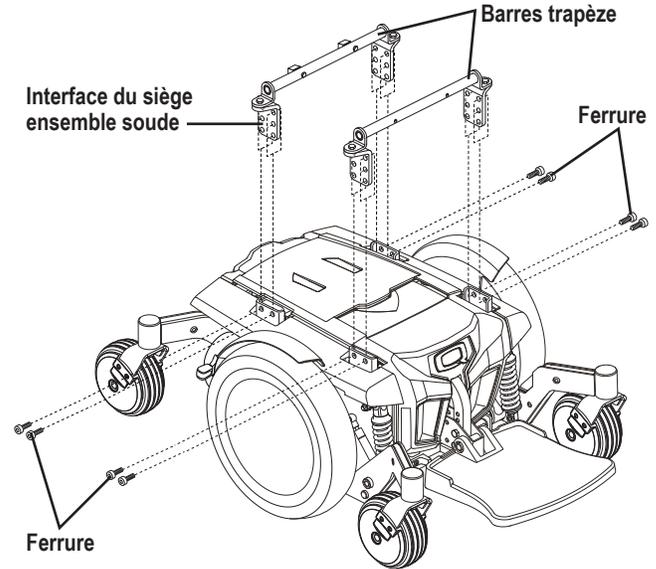


Figure 14. Réglage de la hauteur et de l'angle du siège

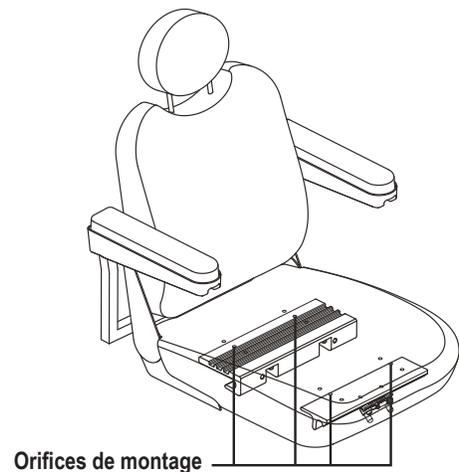


Figure 15. Position du siège

4. Bascule le loquet du siège vers le haut. Voir la figure 6
5. Comprimez le loquet pour détachez le siège de la barre trapèze avant.
6. Faites glisser le siège vers l'avant et retirez-le de la base.
7. Desserrez les ferrures qui retiennent la barre trapèze sur les ensembles soudés de l'interface du siège. Voir la figure 14.
8. Déplacez les barres trapèze vers le niveau désiré.

**REMARQUE:** Changez l'inclinaison en haussant ou abaissant une barre trapèze seulement (avant ou arrière).

9. Réinstallez les ferrures.
10. Reinstall the seat.
11. Rebranchez le contrôleur à la base motorisée.

### Position du siège

Vous pouvez changer la position du siège en changeant la position des fixations sur les montants.

#### Pour changer la position:

1. Coupez le contact (off).
2. Assurez-vous que le fauteuil motorisé est embrayé.
3. Débranchez le connecteur du module de contrôle de la base motorisée.
4. Retirez le siège.
5. Retirez les deux montants sous le siège.
6. Repositionnez les montants dans un ensemble différent d'orifices de montage. Vous devez régler les montants en ayant un nombre identique d'orifices devant et derrière la fixation sur chaque montant. **Voir la figure 15.**
7. Réinstallez les montants sous le siège.
8. Réinstallez le siège.
9. Branchez le connecteur du module de contrôle à la base motorisée.

### Siège à dossier inclinable

Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un siège à dossier inclinable, vous pouvez changer l'inclinaison du dossier. Le levier est situé sur le droit côté de la base du siège.

#### Pour changer l'inclinaison du dossier:

1. Tirez sur le levier.
2. Changez la position du dossier.
3. Relâchez le levier.

### Réglage en largeur des appuis-bras

Le réglage est indépendant pour chaque appui-bras.

**REMARQUE: Le réglage des appuis-bras peut faire augmenter la largeur hors tout de votre fauteuil motorisé.**

#### Pour ajuster les appuis-bras en largeur:

1. Repérez les deux boutons de réglage sur le support des appuis-bras. **Voir la figure 16.**
2. Desserrez les boutons.
3. Faites glisser les appuis-bras à la position désirée.
4. Resserrez les boutons.

### Inclinaison des appuis-bras

#### Pour changer l'inclinaison des appuis-bras:

1. Relevez l'appui-bras perpendiculaire au plancher. **Voir la figure 16.**
2. Desserrez l'écrou de blocage.
3. Tournez la vis de réglage pour soulever ou abaisser l'avant de l'appui-bras.
4. Resserrez l'écrou pour verrouiller en place.

### Hauteur des appuis-bras

#### Pour changer la hauteur des appuis-bras:

1. Desserrez les vis de blocage sur les dos de chaque support d'appui-bras. **Voir la figure 16.**
2. Élevez ou abaissez les appuis-bras vers le niveau désiré.
3. Resserrez les vis de blocage sur chaque appui-bras.

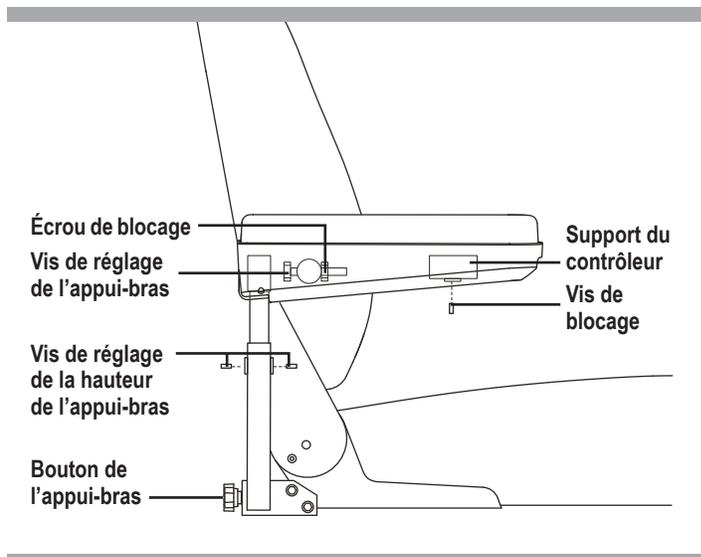


Figure 16. Réglages des appuis-bras et dossier

### Position du contrôleur

Vous pouvez approcher ou éloigner de vous le contrôleur. Vous pouvez également l'installer sur l'appui-bras droit ou gauche.

#### **⚠ MISE EN GARDE!**

**Ne placez pas le câble de façon à ce qu'il puisse être coincé entre le cadre du siège et la structure de la base motorisée.**

#### Pour allonger le support de contrôleur:

1. Relevez l'appui-bras à la verticale.
2. Desserrez la vis de blocage sous l'appui-bras. **Voir la figure 16.**
3. Faites glisser le contrôleur vers la position désirée.
4. Resserrez la vis pour fixer le contrôleur.

#### Pour changer la position du contrôleur:

1. Coupez le contact (off).
2. Débranchez les connecteurs du contrôleur de la base motorisée.
3. Coupez l'attache plastique qui retient le câble sous l'appui-bras.
4. Relevez l'appui-bras perpendiculaire au plancher.
5. Desserrez la vis de blocage sur le support du contrôleur.
6. Glissez le contrôleur hors de l'appui-bras.
7. Desserrez la vis de blocage sur l'autre appui-bras.
8. Placez le contrôleur dans l'autre appui-bras.
9. Resserrez les vis de blocage sur chaque appui-bras.
10. Faites passer le câble du contrôleur vers l'arrière de la base motorisée et branchez-le.
11. Fixez le câble du contrôleur sur l'appui-bras avec des attaches pour câble. **Voir la figure 8.**

**REMARQUE: Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un Siège Synergy ou d'un système TRU-Balance 3, référez aux informations comprises dans le manuel fourni avec le système de siège.**

### Hauteur du repose-pieds

Le repose-pieds peut être placé à plusieurs hauteurs différentes.

#### Pour relever ou abaisser le repose-pieds:

1. Retirez les ferrures sur le support du repose-pieds. **Voir la figure 17.**
2. Relevez ou abaissez le repose-pieds à la hauteur désirée.
3. Réinstallez les ferrures sur le support du repose-pieds et resserrez bien.

### Profondeur de la plateforme

La profondeur du plateau du repose-pieds est réglable.

#### Pour ajuster la profondeur de la plateforme:

1. Retirez les ferrures sur le support du repose-pieds. **Voir la figure 17.**
2. Placez la plateforme à la profondeur désirée.
3. Réinstallez les ferrures sur le support du repose-pieds et resserrez bien.

### Réglage de l'angle du repose-pieds

Vous pouvez régler l'inclinaison du plateau du repose-pieds.

#### Pour régler l'inclinaison du repose-pieds:

1. Relevez le repose-pieds pour trouver l'emplacement de la vis de réglage. **Voir la figure 17.**
2. Tournez la vis de réglage pour soulever ou abaisser l'avant du repose-pieds.

### Siège électrique élévateur (optionnel)

Si votre fauteuil motorisé est équipé d'un siège élévateur motorisé, vous pouvez régler la hauteur du siège soit à l'aide du contrôleur, à l'aide d'un interrupteur à bascule ou à l'aide d'un interrupteur simple en option monté sur l'un des accoudoirs.

#### Pour changer la hauteur du siège via la commutateur à bascule:

1. Pesez sur l'avant du commutateur pour faire monter le siège. **Voir la figure 18.**
2. Pesez sur l'arrière du commutateur pour faire descendre le siège.

### MISE EN GARDE!

Ne laissez pas le moteur rouler pendant plus de quelques secondes lorsque le siège est en fin de course supérieure ou inférieure.

#### Pour régler la hauteur du siège à l'aide de l'interrupteur simple:

1. Appuyez et maintenez le bouton de l'interrupteur simple pour lever le siège. Relâchez le bouton pour arrêter.
2. Appuyez et maintenez le bouton de l'interrupteur simple pour abaisser le siège. Relâchez le bouton pour arrêter.

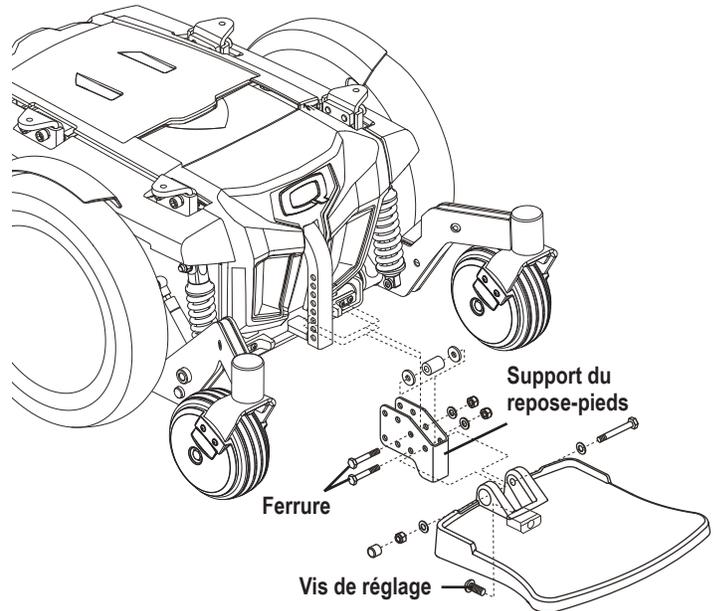


Figure 17. Ajustement de repose-pieds

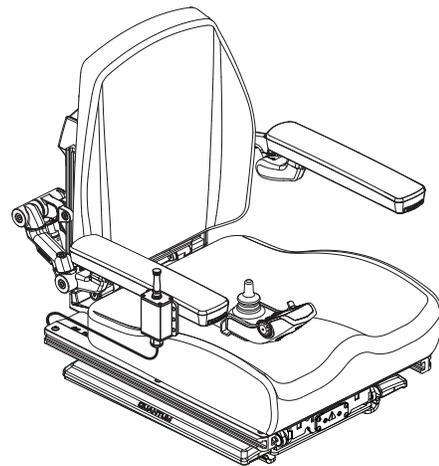


Figure 18. Commutateur du siège électrique

#### Si une fonction de verrouillage est activée:

1. Appuyez le bouton de l'interrupteur simple pour lever le siège. Appuyez à nouveau le bouton de l'interrupteur simple pour arrêter.
2. Appuyez le bouton de l'interrupteur simple pour abaisser le siège. Appuyez à nouveau le bouton de l'interrupteur simple pour arrêter.

**REMARQUE:** Contactez votre détaillant Quantum Rehab pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre siège élévateur.

### ⚠ MISE EN GARDE!

Le siège élévateur est conçu pour l'utilisation sur une surface bien à niveau seulement. Ne tentez jamais d'élever le siège de son niveau inférieur lorsque le fauteuil est sur une surface inclinée sous peine de provoquer un renversement.

Ne jamais élever le siège de son niveau inférieur lorsque vous roulez sous peine de provoquer un renversement.

Ne jamais élever le siège de son niveau inférieur lorsque le fauteuil est débrayé (neutre).

Attachez toujours le ceinture de positionnement lorsque vous élevez le siège.

**REMARQUE:** Le siège électrique est équipé d'un dispositif de sécurité qui réduit la vitesse de votre fauteuil dès que le siège est élevé. Assurez-vous que le dispositif de sécurité est bien fonctionnel avant de vous servir de votre fauteuil.

#### Ceinture de positionnement

Votre fauteuil motorisé peut être équipé d'une ceinture de positionnement réglable pour un meilleur confort. Voir la figure 19. La ceinture de positionnement, réglable, a été conçue pour soutenir et empêcher tout glissement vers le bas ou vers l'avant une fois assis. La ceinture de positionnement n'a pas été conçue pour être utilisée comme ceinture de sécurité.

### ⚠ MISE EN GARDE!

La ceinture de positionnement n'est pas conçue pour être utilisée comme ceinture de sécurité dans un véhicule à moteur. Toute personne voyageant dans un véhicule doit être correctement attaché dans les sièges approuvés par le véhicule fabricant. Votre fauteuil motorisé n'est pas adapté pour être utilisé comme un siège dans tout véhicule à l'exception suivante: le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'arrimage pour fauteuil roulant et système de retenue des occupants (WTORS) qui a été installé conformément aux instructions du fabricant du dispositif d'arrimage instructions et est conforme à la norme ANSI/RESNA WC/Vol. 4, normes Section 18/ISO 10542 et le fauteuil motorisé doit disposer d'un système de sécurisation du transit conforme à ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Section 19/ISO 7176-19 normes. Il est essentiel d'utiliser un WTORS complet pour fixer le fauteuil motorisé au véhicule et fournir l'occupant du fauteuil motorisé avec un et système de retenue de sécurité testé. Un système de retenue avec des ceintures pelviennes et supérieures du torse doivent être utilisées pour protéger

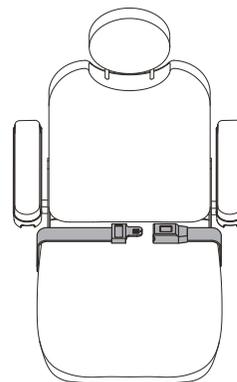


Figure 19. Ceinture de positionnement

### ⚠ MISE EN GARDE!

l'occupant du fauteuil motorisé et minimiser probabilité de blessure causée par le contact avec le véhicule lors d'un accident ou d'un freinage brusque.

La ceinture de positionnement doit être sécurisée à tout moment. Ne laissez jamais la ceinture de positionnement suspendue en l'air ou trainer sur le sol car elle peut s'emmêler.

#### Pour installer la ceinture du positionnement:

1. Retirez la vis sur la partie arrière de la charnière de siège du côté gauche et du côté droit.
2. Insérez une vis dans la rondelle fournie et au travers de la ceinture puis dans la charnière de chaque côté du siège.
3. Resserrez les vis.

#### Pour ajuster la ceinture et augmenter le confort:

1. Prenez place sur le siège, insérez la patte métallique d'un côté dans le boîtier de la boucle du côté opposé jusqu'à ce que le « clic » se fasse entendre. Voir la figure 19.
2. Tirez la courroie excédentaire pour ajuster la ceinture, sans trop serrer pour ne pas créer d'inconfort.

#### Pour détacher la ceinture de positionnement:

1. Pesez sur le bouton de détente du mécanisme sur le boîtier de plastique.

### ■ OBLIGATOIRE!

Assurez-vous que la ceinture est bien fixée et bien confortable avant chaque usage.

Inspectez la ceinture pour des pièces détachées ou des dommages, y compris des déchirures, des zones usées, de la quincaillerie pliée ou des mécanismes de verrouillage endommagés, de la saleté ou des débris, avant chaque usage. Si vous découvrez un problème, contactez votre détaillant Quantum Rehab pour les réparations.

## Batteries et recharge

Votre fauteuil motorisé utilise deux batteries 12 volts à décharge profonde. Ces batteries sont scellées et ne demandent aucun entretien. Il n'est pas nécessaire de vérifier le niveau de liquide. Elles ont été conçues pour être entièrement déchargées. Les batteries à décharge profonde ressemblent à des batteries d'automobile mais ces dernières ne peuvent être utilisées dans un fauteuil motorisé puisqu'elles n'ont pas été conçues pour être entièrement déchargées. Les batteries de type automobile peuvent être dangereuses lorsqu'utilisées dans un fauteuil motorisé.

### **OBLIGATOIRE!**

Les bornes, les connecteurs et les accessoires reliés aux batteries contiennent du plomb. Portez des lunettes de protection et des gants pour les manipuler. Lavez vos mains après les avoir manipulés.

### **MISE EN GARDE!**

Contactez votre détaillant Quantum Rehab si vous avez des questions au sujet des batteries de votre fauteuil motorisé.

**UTILISEZ UNIQUEMENT** des batteries et un chargeur de batterie qui ont été fournis avec votre fauteuil motorisé ou qui ont été testés et approuvés par Quantum pour une utilisation avec votre modèle spécifique de fauteuil motorisé. L'utilisation de batteries ou d'un chargeur de batterie qui n'ont pas été testés et approuvés par Quantum peut provoquer un dysfonctionnement, y compris, mais sans s'y limiter, un événement thermique, susceptible de provoquer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

### **INTERDIT!**

Toujours utiliser deux batteries identiques, de même type, de même débit et de même capacité (Ah). Référez-vous aux spécifications contenues dans ce manuel ou dans le manuel du chargeur à batteries pour connaître le type et le modèle recommandé.

### Recharge des batteries

La chargeur de batteries est indispensable pour prolonger la durée de vie utile des batteries de votre fauteuil motorisé. Le chargeur a été conçu pour optimiser la performance de votre fauteuil motorisé en rechargeant vos batteries de façon sécuritaire, rapide et efficace.



**INTERDIT!** Ne pas retirer la fiche de mise à la terre sous peine de provoquer un incendie. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un adaptateur à trois fiches dans une prise électrique à deux fiches.



**INTERDIT!** N'utilisez jamais de cordon de rallonge pour brancher le chargeur de batteries. Branchez le chargeur directement dans une prise murale.



**INTERDIT!** Ne laissez pas d'enfants jouer sans surveillance près d'un fauteuil motorisé lorsque vous rechargez les batteries. Quantum Rehab recommande de ne pas recharger les batteries lorsque le fauteuil est occupé.



**OBLIGATOIRE!** Lisez les instructions sur le recharge des batteries dans ce manuel et/ou dans le livret fourni avec le chargeur avant de commencer la recharge.



**MISE EN GARDE!** La recharge des batteries peut générer des gaz explosifs. N'approchez pas du chargeur avec une flamme ou des étincelles. Ventilez adéquatement pendant la recharge des batteries.



**MISE EN GARDE!** Vous devez recharger les batteries avec le chargeur externe qui été fourni avec votre fauteuil. N'utilisez pas un chargeur de type automobile.



**MISE EN GARDE!** Inspectez le chargeur, les fils et les connecteurs pour déceler des dommages utilisation. Contactez avant chaque votre détaillant Quantum Rehab si vous découvrez des dommages.



**MISE EN GARDE!** Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier du chargeur à batteries. Si votre chargeur ne fonctionne pas correctement, contactez votre détaillant Quantum Rehab.



**MISE EN GARDE!** Soyez conscient que le boîtier du chargeur de batterie peut devenir chaud pendant la charge. Évitez tout contact cutané et ne placez pas dessus des surfaces susceptibles d'être affectées par la chaleur.



**MISE EN GARDE!** Si votre chargeur à batteries externe est muni de fentes de ventilation, n'insérez pas d'objet au travers de ces fentes.



**MISE EN GARDE!** Si votre chargeur à batteries externe n'a pas été testé et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur, ne l'exposez pas à des mauvaises conditions météo. Si le chargeur est exposé à des mauvaises conditions météo, alors laissez reposer le chargeur afin qu'il s'acclimate à l'intérieur avant de l'utiliser. Référez-vous au manuel qui accompagne le chargeur pour de plus amples informations.

**Pour recharger les batteries à l'aide du chargeur externe:**

1. Placez l'avant du fauteuil près d'une prise électrique ordinaire.
2. Assurez-vous que le contact est coupé (off) et que les leviers sont en position « embayé ».
3. Branchez le connecteur à 3-fiches du câble du chargeur externe dans le réceptacle de programmation/chargeur sur le contrôleur. **Voir la figure 20.**
4. Branchez le chargeur externe dans la prise murale.
5. Lorsque les batteries sont complètement rechargées, débranchez le chargeur de la prise murale et du contrôleur.

**⚠ MISE EN GARDE!**

Les voyants lumineux sur le chargeur vous informent sur l'état actuel: le chargeur est allumé, le chargeur est en marche ou la recharge est complétée. Si dans les 24 heures, la DEL n'indique pas que la charge est terminée, débrancher le chargeur de la prise et contactez votre détaillant Quantum Rehab. Référez-vous au manuel fourni avec le chargeur pour les instructions complètes sur les voyants lumineux.

Le chargeur de batterie peut avoir des voyants qui s'allument dans certaines conditions. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le chargeur pour une explication complète de ces indicateurs.

**Avertissement d'indication du chargeur :**

Lorsque votre fauteuil motorisé est branché pour charger, votre contrôleur indiquera la charge et l'interdiction de conduire en faisant défiler votre indicateur de batterie en continu (indication déterminée par l'électronique de votre fauteuil motorisé).

**Remarque: Votre fauteuil motorisé peut être équipé d'accessoires ou de fonctions de siège qui utilisent le circuit de charge du module d'alimentation pour la fonctionnalité et/ou l'inhibition de la conduite. Si vous remarquez que les indicateurs de batterie défilent et que la conduite est inhibée, mais que le chargeur n'est pas branché sur le contrôleur, vérifiez votre position assise ou appelez votre fournisseur Quantum agréé.**

**Indicateur de charge de batterie Q-Logic 3**

Si votre chargeur de batterie est connecté au contrôleur mais pas à la prise électrique, le système de contrôle Q-Logic 3 affiche un avertissement indiquant que le système ne se charge pas. **Voir la figure 21.**

**Pour effacer cette erreur lorsqu'elle se produit:**

1. Si le système est éteint avec le chargeur branché sur le contrôleur, débranchez le chargeur du contrôleur.
2. Si le système est sous tension, débranchez le chargeur du contrôleur, puis éteignez puis rallumez le système.

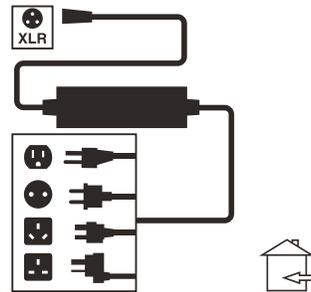


Figure 20. Recharge des batteries



Figure 21. Indicateur de charge de batterie Q-Logic 3

**Rodage des batteries****Pour roder les nouvelles batteries et obtenir une efficacité maximale:**

1. Rechargez complètement vos batteries neuves avant l'utilisation initiale. À ce stade, elles offriront environ 90% de leur performance.
2. Essayez votre fauteuil motorisé autour de votre domicile. Déplacez-vous d'abord lentement et ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé avec les commandes et que les batteries soient rodées.
3. Rechargez complètement vos batteries pendant une période de au moins 8 à 14 heures avant d'utiliser votre fauteuil motorisé. Les batteries offriront plus de 90% de leur potentiel.
4. Après quatre à cinq cycles de recharge, vos batteries atteindront 100% de performance et dureront plus longtemps.

**Questions fréquemment posées (FAQ)****Comment fonctionne le chargeur?**

Le chargeur utilise le courant électrique standard (courant alternatif) et le convertit en courant de 24V DC (courant direct). Les batteries du fauteuil se servent du courant direct pour alimenter votre fauteuil motorisé. Si les batteries sont faibles, le chargeur travaille plus fort. À mesure que les batteries se rechargeront, le chargeur ralentit le niveau de recharge jusqu'à ce que les batteries soient complètement chargées. Lorsque les batteries sont complètement rechargées, l'aiguille de l'ampèremètre du chargeur oscille près du zéro. C'est ainsi que le chargeur recharge les batteries sans les surcharger.

### Puis-je utiliser un autre chargeur?

Pour conserver vos batteries dans le meilleur état possible, nous recommandons de les recharger avec un chargeur pour fauteuil motorisé. Nous ne recommandons pas l'usage d'autres types de chargeur (ex: un chargeur de batteries d'automobile).

**REMARQUE:** *Votre chargeur de fauteuil motorisé ne peut pas être utilisé avec des batteries totalement à plat. Dans ce cas, contactez votre détaillant Quantum Rehab pour obtenir de l'aide.*

### À quelle fréquence dois-je recharger les batteries?

Plusieurs facteurs influencent la nécessité de recharger les batteries. Vous pouvez, par exemple, utiliser votre fauteuil motorisé tous les jours ou ne pas l'utiliser pendant plusieurs semaines.

#### ■ Usage quotidien

Si vous utilisez votre fauteuil motorisé quotidiennement, rechargez vos batteries dès que vous avez terminé de l'utiliser. Votre fauteuil motorisé sera rechargé tous les matins et prêt pour toute une journée d'utilisation. Nous recommandons de recharger vos batteries pendant une période allant d'au moins 8 à 14 heures après une journée d'utilisation. Quantum Rehab recommande de charger les batteries pendant 4 heures supplémentaires après que le chargeur de la batterie indique que la charge est terminée.

#### ■ Usage occasionnel

Si vous utilisez votre fauteuil motorisé de temps à autre (une fois par semaine ou moins), nous recommandons de recharger les batteries au moins une fois par semaine pendant au moins 24 heures.

**REMARQUE:** *Gardez vos batteries bien rechargées et évitez de les décharger complètement. Reportez-vous au manuel fourni avec le chargeur de batterie pour des instructions de recharge. Quantum Rehab recommande de charger vos batteries pendant au moins 48 heures consécutives une fois par mois afin d'améliorer les performances et la vie de la batterie.*

### Comment obtenir une distance maximale avec les batteries?

Les conditions de conduite ne sont jamais idéales, telles qu'un terrain plat et lisse, sans vent, ni pentes, ni virages. Bien souvent nous faisons face à des pentes, des fissures dans les trottoirs, des surfaces rugueuses ou accidentées, des virages et du vent. Ces facteurs affectent la distance que vous pouvez parcourir avec votre fauteuil. Veuillez trouver ci-dessous quelques suggestions pour obtenir une distance maximale:

- Ayez toujours des batteries entièrement rechargées avant de partir.
- Planifiez vos sorties de façon à éviter les pentes, dans la mesure du possible.
- Emportez le minimum de bagages.

- Essayez de maintenir une vitesse uniforme et évitez de vous arrêter trop souvent.
- Quantum Rehab recommande de charger vos batteries pendant au moins 48 heures consécutives une fois par mois afin d'améliorer les performances et la vie de la batterie.

### Quel type de batteries devrais-je utiliser?

Nous recommandons les batteries à décharge profonde, scellées, ne demandant aucun entretien. La performance des batteries à décharge profonde AGM et Gel-Cell est semblable. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les batteries d'un fauteuil motorisé, référez-vous au tableau des spécifications.



### MISE EN GARDE!

**Les batteries contiennent des produits chimiques corrosifs. N'utilisez que des batteries AGM ou Gel-Cell afin de réduire les risques de fuite ou d'explosion.**

### Pourquoi mes nouvelles batteries sont faibles?

Les batteries à décharge profonde sont très différentes des batteries utilisées dans une voiture, des batteries au nickel-cadmium ou tout autre type de batterie ordinaire. Les composants chimiques utilisés dans les batteries à décharge profonde augmentent leur puissance et permettent de les recharger rapidement. Les batteries au plomb acide doivent être rechargées fréquemment. Ces batteries ne disposent pas de mémoire comme les batteries nickel-cadmium.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur de batteries pour fournir des batteries les mieux adaptées aux besoins spécifiques de votre fauteuil. Des batteries neuves arrivent continuellement chez Quantum Rehab et elles sont expédiées complètement chargées. Le transport peut cependant les exposer à des températures parfois extrêmes qui peuvent influencer leur performance. En effet, la chaleur et le froid extrêmes réduisent leur charge et prolongent le temps nécessaire pour les recharger (comme pour les batteries d'automobile).

Une batterie peut prendre quelques jours pour se stabiliser à la température ambiante. En outre, il est important de noter qu'il faudra quelques utilisations et recharges avant qu'elles atteignent l'équilibre chimique essentiel à leur performance et à leur longévité. Il est donc important que vous preniez le temps de roder correctement vos batteries.

### Comment puis-je prolonger la vie de mes batteries?

Une batterie à décharge profonde totalement rechargée permettra une meilleure performance et une vie utile prolongée. Essayez de toujours maintenir vos batteries totalement rechargées. Les batteries qui ne sont pas rechargées assez souvent ou qu'on laisse se décharger complètement, ou encore que l'on entrepose déchargées peuvent être endommagées affectant la performance de votre fauteuil motorisé ou en raccourcissant la vie utile des batteries.

**REMARQUE: La fiabilité des batteries est proportionnelle aux soins qu'elles ont reçus.**

### **Comment dois-je entreposer mon fauteuil motorisé et ses batteries?**

Si vous utilisez votre fauteuil motorisé occasionnellement, nous recommandons de garder vos batteries pleinement rechargées. Pour ce faire, vous devez les recharger au moins une fois par semaine.

Si vous pensez ne pas utiliser votre fauteuil motorisé pendant une période prolongée, rechargez les batteries complètement avant de l'entreposer. Débranchez les batteries et entreposez votre fauteuil motorisé dans un endroit sec et chaud. Évitez les températures extrêmes, telles que le gel ou les canicules, et surtout n'essayez pas de recharger une batterie gelée. Une batterie froide ou gelée devrait demeurer à la température de la pièce pendant plusieurs jours avant d'être rechargée.

### **Au sujet des transports publics?**

Les batteries AGM et Gel-Cell sont conçues pour être utilisées dans les fauteuils électriques et autres véhicules de mobilité. Ces batteries sont conformes aux exigences de la Federal Aviation Administration (FAA) (États-Unis uniquement), permettant un transport en toute sécurité dans les avions, les bus et les trains, car il n'y a aucun risque de déversement ou de fuite. Nous vous suggérons de contacter le guichet du transporteur à l'avance pour déterminer les exigences spécifiques de ce transporteur.

### **Au sujet de l'expédition?**

Si vous souhaitez expédier votre fauteuil motorisé par transporteur, nous vous recommandons d'utiliser son emballage d'origine et d'emballer les batteries séparément.



## Soins et entretien

Les fauteuils motorisés sont des appareils sophistiqués. Comme tout véhicule motorisé, il requiert un entretien de routine. Vous pouvez faire la plupart des vérifications tandis que d'autres tâches doivent être faites chez votre détaillant Quantum Rehab. Un entretien préventif est très important. Il vous permet d'optimiser les performances de votre fauteuil pendant plusieurs années. Suivez les instructions de la cédule pour entretenir votre fauteuil motorisé. Si vous avez des questions, contactez votre détaillant Quantum Rehab.

### MISE EN GARDE!

**Ne pas faire l'entretien de votre fauteuil motorisé lorsqu'une personne y est assise.**

Votre fauteuil, comme tout équipement électrique, est sensible aux conditions météorologiques. Évitez les endroits humides.

### MISE EN GARDE!

**Une exposition prolongée ou directe à l'eau ou à l'humidité peut entraîner des problèmes électroniques et mécaniques. L'eau provoque des problèmes électriques et cause la corrosion de la structure du fauteuil. Un fauteuil motorisé doit être examiné périodiquement pour détecter de la corrosion causée par l'exposition à l'eau, liquides corporels ou l'incontinence. Les composantes endommagées doivent être remplacées ou réparées immédiatement.**

#### Si votre fauteuil est exposé à l'eau:

1. Asséchez le fauteuil le mieux possible.
2. Laissez-le dans un endroit sec et chaud pour au moins 12 heures de façon à ce que l'eau qui s'est infiltrée puisse s'évaporer entièrement.
3. Vérifiez le fonctionnement de la manette et des freins de votre fauteuil avant de l'utiliser.
4. Si vous découvrez un problème, apportez votre le fauteuil chez votre détaillant Quantum Rehab. Un fauteuil motorisé qui est fréquemment exposé à de l'humidité telle que l'incontinence doit être inspecté régulièrement afin de déceler la corrosion.

#### Température

- Bien que votre fauteuil motorisé puisse supporter des températures de stockage à court terme comprises entre -40 °F (-40 °C) et 149 °F (65 °C), il est recommandé que les températures de stockage à long terme soient comprises entre -13 °F (-25 °C) et 122 °F (50 °C). Les conditions de stockage idéales sont de 68 °F (20 °C) à 70 °F (21 °C) dans la mesure du possible, mais nous réalisons que ce n'est pas toujours possible en raison des différents climats et environnements.
- Des températures de froid extrême peuvent faire geler les batteries. La température spécifique à laquelle vos batteries gèlent dépend de plusieurs facteurs comme leur niveau de charge, l'utilisation que vous en faites et leur composition.

## Directives générales

- Évitez de heurter le module de contrôle et plus spécialement la manette.
- Évitez d'exposer votre fauteuil motorisé à des conditions extrêmes de froid, de chaleur ou d'humidité.
- Le module de contrôle doit toujours être propre.
- Vérifiez les branchements sur le cabaret électronique afin de garantir qu'ils soient tous bien serrés.
- Gonflez toujours les pneus de traction à la pression en psi/bar/kPa indiquée.

### MISE EN GARDE!

**Gardez vos pneus gonflés à la pression en psi/bar/kPa indiquée en tout temps. Ne pas sousgonfler ou surgonfler vos pneus. Un pneu trop mou peut provoquer une perte de contrôle tandis qu'un pneu trop gonflé peut exploser.**

**N'utilisez pas une source sans régulateur de pression pour gonfler vos pneus.**

- Protégez les flancs de vos pneus avec un conditionneur.

### MISE EN GARDE!

**N'utilisez jamais de conditionneur sur la bande de roulement sous risque de rendre les pneus glissants et de faire déraiper votre fauteuil motorisé.**

- Tous les roulements à billes des essieux sont lubrifiés à l'usine et scellés. Ils ne nécessitent aucune lubrification subséquente.
- Si votre fauteuil motorisé dispose d'un carénage avec une  **finition brillante** , le carénage a été pulvérisé avec un revêtement d'étanchéité transparent. Vous pouvez appliquer une légère couche de cire de voiture pour l'aider à conserver son aspect brillant. Si votre fauteuil motorisé dispose d'un carénage avec une  **finition mate** , utilisez UNIQUEMENT les produits développés pour la peinture mate. N'utilisez pas de cire, d'aérosol de nettoyage, ArmorAll® ou tout autre produit fabriqué pour des peintures brillantes.

### MISE EN GARDE!

**Choisissez avec précaution le produit approprié pour protéger la finition du ou des carénages de votre fauteuil motorisé. Seuls les produits développés pour la peinture mate doivent être utilisés sur des carénages avec une finition mate. Le non-respect de cette mise en garde peut endommager le fini de peinture mate du carénage.**

- Inspectez tous les raccords électriques. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés et libres de corrosion. Les batteries doivent être bien à plat dans le puits à batteries, avec les bornes de batterie qui font face à l'arrière. Référez-vous au diagramme pour la bonne mise en place des batteries.

**⚠ MISE EN GARDE!**

**Même si votre fauteuil a réussi un test de résistance à l'humidité, éloignez-le des sources d'humidité ou de liquide tel que les eaux de lavage et l'incontinence. Inspectez régulièrement les composantes pour déceler la corrosion.**

**Entretien quotidien**

- Coupez le contact avant de vérifier la manette de commande. Assurez-vous que le mât de la manette n'est pas tordu et qu'il revient bien à la verticale lorsque vous le relâchez. Vérifiez la housse de caoutchouc, s'il y a des dommages, ne tentez pas de les réparer, contactez plutôt votre détaillant Quantum Rehab.
- Inspectez visuellement le câble du module. Si vous découvrez des coupures ou des fils exposés, contactez votre détaillant Quantum Rehab.
- Vérifiez les déformations sur les pneus anti-crevaisons. Ils peuvent affecter la stabilité du fauteuil motorisé.
- Inspectez le système de siège, les appuis-bras, et les repose-pieds, pour déceler du jeu excessif, des dommages ou des signes de stress. Voyez votre détaillant Quantum Rehab si vous trouvez un problème.

**Vérifications hebdomadaires**

- Débranchez le contrôleur du module d'alimentation pour l'inspecter. Vérifiez qu'il n'y a pas de traces de corrosion. Contactez votre détaillant Quantum Rehab au besoin.
- Assurez-vous que toutes les pièces du module de contrôle sont bien fixées au fauteuil motorisé. Ne serrez pas les vis avec excès.
- Vérifiez la pression des pneus. Elle doit être à la pression en psi/bar/kPa indiquée dans chaque pneu. Si un pneu fuit, voyez votre détaillant Quantum Rehab pour obtenir un tube de rechange.
- Vérifiez les freins. Ce test doit être exécuté sur une surface à niveau et avec au moins un mètre (3 pieds) de dégagement autour de votre fauteuil motorisé.

**Pour vérifier les freins:**

1. Mettez le contact et réglez le bouton de vitesse au plus lent.
2. Attendez une seconde et vérifiez l'état des batteries. La tension doit se maintenir.
3. Poussez doucement sur la manette jusqu'à ce que vous entendiez les freins électriques se relâcher. Relâchez immédiatement la manette. Vous devez entendre le déclic presque immédiatement à chaque fois que vous poussez la manette. Répétez ce test trois fois vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite.

**Vérifications mensuelles**

- Vérifiez l'usure des pneus des roues motrices. Voyez votre détaillant Quantum Rehab pour les remplacer.
- Vérifiez les roues pivotantes. Remplacez-les au besoin.
- Vérifiez les fourches. Si elles oscillent, les roulements à billes doivent être remplacés. Contactez votre détaillant Quantum Rehab à ce sujet.

- Vérifiez l'ensemble du fauteuil motorisé pour vous assurer qu'il n'y a pas de quincailerie desserrée, des changements dans la fonction ou dans la performance du fauteuil motorisé. Voyez votre détaillant Quantum Rehab autorisé pour le service ou la réparation.
- Gardez votre fauteuil motorisé bien propre, enlevez la boue, les cheveux, la nourriture, etc.
- Faites une inspection visuelle des ressorts et des amortisseurs. Contactez votre détaillant Quantum Rehab si vous détectez des anomalies, des dommages ou des déformations.

**Vérifications annuelles**

Apportez votre fauteuil chez votre détaillant Quantum Rehab au moins une fois par année pour une inspection, surtout si vous utilisez votre fauteuil régulièrement. Vous serez ainsi assuré qu'il fonctionne correctement et vous préviendrez des complications futures.

**Entreposage**

Votre fauteuil motorisé doit être entreposé dans un endroit sec à température contrôlée. Pour l'entreposage, débranchez les batteries de votre fauteuil motorisé. Voir "Batteries et recharge".

**⚠ MISE EN GARDE!**

**Si le fauteuil n'a pas été entreposé correctement, sa structure sera affectée par la rouille tandis que ses circuits électroniques s'endommageront.**

Des batteries qui sont souvent trop déchargées, rarement rechargées, entreposées dans des conditions extrêmes, ou entreposées sans avoir été rechargées peuvent être endommagées et ne seront plus performantes. Il est recommandé de recharger les batteries périodiquement pendant la période d'entreposage afin d'assurer une bonne performance.

Placez des blocs de bois sous le cadre du fauteuil pour l'entreposage long terme. Ceci enlèvera le poids du fauteuil des pneus afin de prévenir leur déformation.

**Comment disposer de votre fauteuil motorisé**

Vous devez disposer de votre fauteuil en respectant les règlements en vigueur dans votre localité. Contactez votre centre de recyclage ou votre détaillant Quantum Rehab pour les informations pour la mise au rebut de l'emballage, des composantes métalliques, plastiques, électroniques, batteries, néoprène, silicone, et les matériaux de polyuréthane.

**⚠ MISE EN GARDE!**

**Les sacs en plastique présentent un risque de suffocation. Jeter les sacs en plastique correctement et ne pas permettre aux enfants de jouer avec eux.**

### Nettoyage et désinfection

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage des équipements/dispositifs médicaux pour réduire le risque de propagation des infections. Il s'agit de limiter la propagation de la maladie et d'autres matières potentiellement infectieuses (OPIM) (composants sanguins).

- Utilisez un chiffon humide et un nettoyeur doux et non abrasif pour nettoyer les pièces en plastique et en métal de votre fauteuil motorisé. Évitez d'utiliser des produits qui pourraient rayer la surface de votre fauteuil motorisé.
- Si nécessaire, nettoyez votre produit avec un désinfectant homologué. Assurez-vous que le désinfectant peut être utilisé sans danger sur votre produit avant l'application.

#### Comment nettoyer/désinfecter l'équipement:

Surfaces dures/molles (enveloppes en plastique, charpente métallique, tissu de siège, pneus, accoudoirs et tapis de repose-pieds, selon le cas)

- Pour les surfaces dures/douces, éliminer la contamination visible si présente.
  - Pour le plastique et le métal, utilisez le spray/lingettes désinfectantes Lysol®/Clorox® et d'autres produits désinfectants qualifiés SARS-CoV-2.
  - Pour les autres surfaces en vinyle, nettoyez avec des lingettes ou des solutions désinfectantes sans danger pour le vinyle.
    - Désinfectants suggérés
      - Désinfectant Birex® SE, vaporisateur désinfectant Bleach-Rite®, germicide Citrace®
      - Dispatch® Spray Nettoyeur hospitalier Désinfectant avec javellisant
      - Solution d'eau de Javel diluée (dilution à 10 % ou moins) ; Remarque : un agent de blanchiment avec un facteur de pH compris entre 7 et 9 convient ; un produit avec un pH de 10,5 ou plus peut endommager l'intégrité de la surface du vinyle sur une longue période de temps.
    - Lingettes désinfectantes
      - Clorox, Green Works, PDI Sani-Cloth HB Wipes, Lysol, Oxivir, Virox et CaviWipes.
  - Pour le nettoyage des pneus, nettoyez avec des nettoyeurs pour pneus/roues disponibles dans le commerce

#### Électronique (manette de commande, affichages améliorés, écrans tactiles, télécommandes, claviers, téléphones cellulaires et tablettes, selon le cas)

- Pour l'électronique, éliminer la contamination visible si présente
  - Éteignez l'appareil et débranchez les piles.
  - Ne vaporisez jamais de liquide directement dans le(s) produit(s).

- Humidifiez un chiffon en microfibre avec un mélange d'une solution d'alcool isopropylique à 70 % et d'eau à 30 %. Le chiffon doit être humide, mais pas dégoulinant ou excessivement mouillé. Séchez soigneusement les surfaces pour éviter l'accumulation de liquides et avant le boxage.

### ⚠ MISE EN GARDE!

**Suivez toutes les instructions de sécurité pour une utilisation correcte du désinfectant et/ou de l'agent de nettoyage avant de l'appliquer sur votre produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une irritation de la peau ou une détérioration prématurée du revêtement et/ou des finitions du fauteuil motorisé.**

**N'utilisez jamais d'agent de nettoyage ou de désinfection, de solvant, de lubrifiant ou tout autre produit sur les plaquettes de frein, les disques de frein, la boîte-pont, le moteur/la boîte de vitesses de votre produit de mobilité. Cela pourrait endommager les composants et/ou les empêcher de fonctionner correctement. Des dommages matériels et/ou corporels peuvent en résulter.**

**N'arrosez jamais votre fauteuil motorisé au jet d'eau et ne le placez jamais en contact direct avec de l'eau. Votre fauteuil motorisé est doté d'un carénage en plastique ABS peint qui permet de le nettoyer facilement avec un chiffon humide.**

**N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer un siège en vinyle, car ils pourraient rendre le siège glissant ou le dessécher et le fissurer. Utilisez de l'eau savonneuse et séchez soigneusement le siège.**



Figure 22. Nettoyage et désinfection

### Remplacement d'un pneu/roue

Si vous faites une crevaison vous pouvez remplacer le tube. Si votre fauteuil est équipé de pneus anti-crevaisons vous devez remplacer la roue entière. Des pneus, des tubes, et des roues de remplacement sont disponibles chez votre détaillant Quantum Rehab.

#### **⚠ MISE EN GARDE!**

Seulement votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien spécialisé peut réparer les roues de votre fauteuil motorisé.

Assurez-vous que le contact est coupé et que le fauteuil est embrayé avant de commencer cette procédure.

Lors du remplacement d'une roue, enlevez seulement les cinq écrous puis retirez la roue. Si vous devez démonter le pneu, dégonflez-le complètement d'abord sous peine de le faire exploser.

Procédez selon les étapes suivantes pour réparer les pneus pleins et gonflables rapidement et en toute sécurité:

1. Mettez le module de contrôle hors tension.
2. Placez le fauteuil sur des cales.
3. Si vous changez un pneu gonflable, dégonflez-le complètement avant d'enlever la roue.
4. Retirez les cinq (5) écrous de roue du moyeu. **Voir la figure 23.**
5. Retirez la roue du moyeu.
6. Retirez les vis qui retiennent les deux parties de la jante ensemble. **Voir la figure 24.**
7. Enlevez le tube de pneu gonflable et remplacez-le par un nouveau ou remplacez le pneu anti-crevaisons en entier.
8. Revissez les deux parties de la jante ensemble en remontant le pneu.
9. Remettez la roue en place.
10. Rétirez les cinq (5) écrous de roue sur le moyeu et resserrez.
11. Gonflez les pneus à la pression en psi/bar/kPa indiquée dans chaque pneu.
12. Retirez les cales sous le fauteuil.

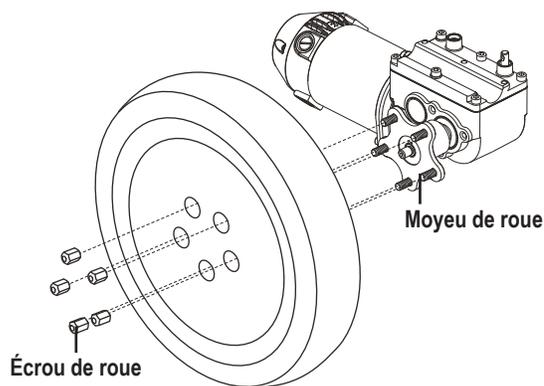


Figure 23. Enlèvement de la roue motrice

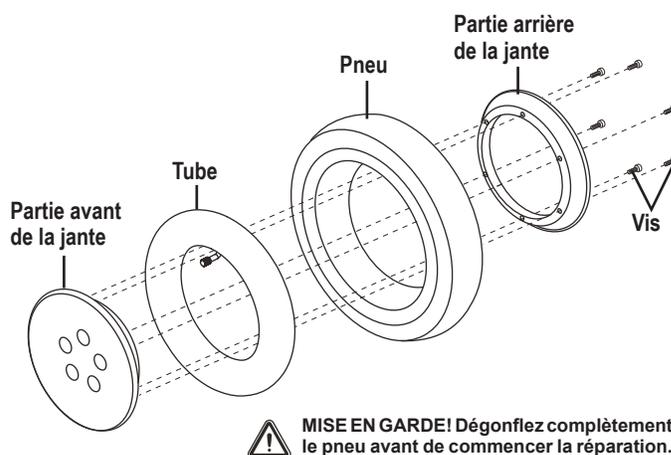


Figure 24. Roue motrice démontée

**Configuration des batteries:**

+ = Borne positive (rouge)

- = Borne négative (noir)

Branchez le fil rouge à la borne positive (+).

Branchez le fil noir à la borne négative (-).

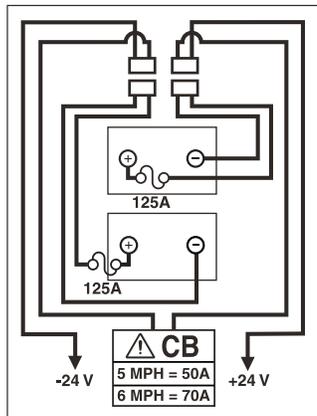


Diagramme de câblage des batteries


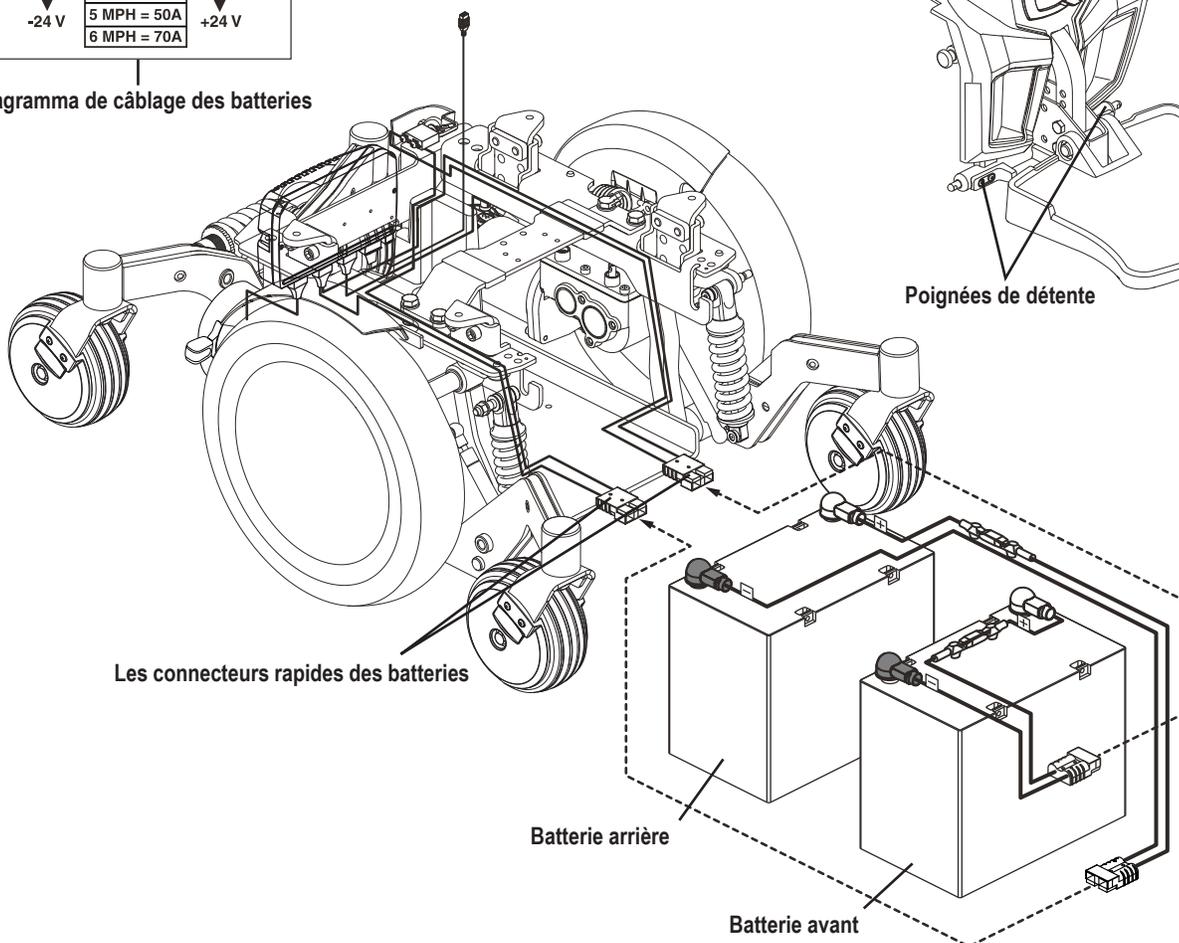


Figure 25. Installation des batteries

### Remplacement d'une batterie

Un diagramme est imprimé sur un autocollant situé sur capot avant. Vérifiez le tableau des spécifications pour connaître les spécifications des batteries.

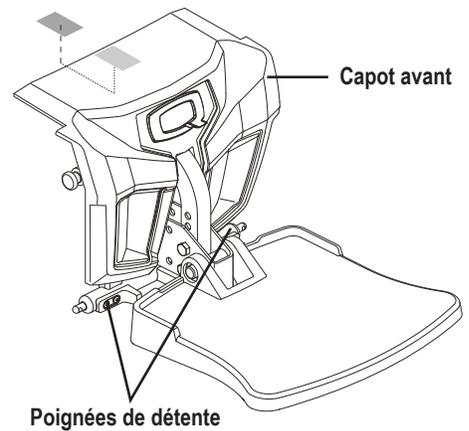

#### OBLIGATOIRE!

Les bornes, les connecteurs et les accessoires reliés aux batteries contiennent du plomb. Portez des lunettes de protection et des gants pour manipuler les batteries. Lavez vos mains après les avoir manipulés.

#### ⚠ MISE EN GARDE!

Les batteries de votre fauteuil doivent être entretenues ou remplacées seulement par votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié.

Ne pas remplacer les batteries du fauteuil lorsqu'une personne y est assise.

Les batteries de votre fauteuil motorisé sont lourdes. Voir le "Tableau des spécifications." Si vous ne pouvez pas soulever un tel poids, demandez de l'aide. Soyez prudent et utilisez une technique appropriée.

Ne coupez pas une batterie neuve avec une batterie usagée. Si vous faites face à une situation où vous devez remplacer une batterie, remplacez les deux par des neuves.

#### ⊘ INTERDIT!

Tenez les outils et autres objets en métal loin des bornes des batteries. Un contact avec un outil en métal peut provoquer un choc électrique.

#### Pour remplacer les batteries:

1. Mettez le module de contrôle hors tension.
2. Assurez-vous que le fauteuil motorisé est embrayé. Voir "Votre fauteuil motorisé".
3. Retirez le capot avant en comprimant les poignées de détente (**voir la figure 24**) et en soulevant le plateau.
4. Débranchez les connecteurs rapides sur les batteries. **Voir la figure 24.**
5. Retirez les batteries.
6. Détachez les fils de chaque batterie.
7. Installez le fil sur la batterie avant selon le diagramme de branchement. **Voir la figure 24.**

#### ⚠ MISE EN GARDE!

Assurez-vous que les attaches sont bien serrées de façon à ce que les connexions soient sécurisées.

8. Installez le fil sur la batterie arrière selon le diagramme de branchement. **Voir la figure 24.**
9. Mettez les nouvelles batteries en place et installez les connecteurs rapides sur les batteries.
10. Réinstallez la capot avant et le repose-pieds.
11. Chargez les batteries. Voir "Batteries et recharge".

### Problèmes à vérifier avec votre détaillant Quantum Rehab

Voici une liste des symptômes graves que vous pourriez possiblement rencontrer. Si vous devez contacter votre détaillant, assurez-vous d'avoir le numéro du modèle, le numéro de série et la nature du problème en note ainsi que le numéro du code si possible.

- Moteur bruyant
- Câbles endommagés
- Connecteur fêlé ou brisé
- Pneus qui s'usent de façon inégale
- Fonctionnement erratique
- Tendances à tanguer vers un côté
- Roues croches ou brisées
- Refuse de s'allumer
- S'allume, mais refuse de bouger
- Siège ou composants de sièges desserrés

#### Solutions aux problèmes

Si votre fauteuil motorisé refuse de s'allumer (voyants lumineux ne s'allument pas) lorsque vous mettez le contact:

- Vérifiez les connecteurs et la connexion du chargeur. Assurez-vous que le tout soit bien serré.
- Vérifiez le disjoncteur et rétablissez le circuit au besoin.
- Vérifiez les connecteurs de bornes des batteries.







## USA

401 York Avenue  
Duryea, PA 18642  
[www.quantumrehab.com](http://www.quantumrehab.com)

## Canada

5096 South Service Road  
Beamsville, Ontario L3J 1V4  
[www.quantumrehab.ca](http://www.quantumrehab.ca)

## Australia

20-24 Apollo Drive  
Hallam, Victoria 3803  
[www.quantumrehab.com.au](http://www.quantumrehab.com.au)

## New Zealand

391 Neilson Street  
Penrose, Auckland 1061  
[www.pridemobility.co.nz](http://www.pridemobility.co.nz)

## UK

(Authorised UK Representative)  
32 Wedgwood Road  
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL  
[www.quantumrehab.co.uk](http://www.quantumrehab.co.uk)

## The Netherlands

(Authorised EU Representative)  
De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen  
[www.quantumrehab.eu](http://www.quantumrehab.eu)  
[www.quantumrehab.nl](http://www.quantumrehab.nl)

## Switzerland

(Authorised CH Representative)  
SODIMED SA  
Chemin Praz Devant 12  
1032 Romanel-sur-Lausanne

## Italy

Via della Tecnica 3  
00065 Fiano Romano-ROMA  
[www.quantumrehab-italia.it](http://www.quantumrehab-italia.it)

## France

26 Rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
[www.quantumrehab.fr](http://www.quantumrehab.fr)

## Spain

Calle Las Minas Número 67  
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón  
28923 Madrid  
[www.quantumrehab.es](http://www.quantumrehab.es)

## Germany

Josef-Förster-Straße 6-8  
33161 Hövelhof  
[www.quantumrehab.de](http://www.quantumrehab.de)

## China

Room 508, Building #4  
TianNa Business Zone  
No. 500 Jianyun Road  
Pudong New Area  
Shanghai 201318  
[www.pridechina.cn](http://www.pridechina.cn)

---

Série #



I N F M A N U 4 6 2 1